

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

la-54

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 MAR. 2000

ADDI' 22 MAR. 2000

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO-ALEANDRI-CIOFFARELLI-DONATO-FEDERICO-MARRONI
ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 837

Oggetto: Casa di Cura privata "Rome American Hospital" di Roma - Modifica ed integrazione DGR n. 2392 del 27.03.1999.



OGGETTO: Casa di Cura privata "ROME AMERICAN HOSPITAL" di Roma - Modifica e integrazione D.G.R. n. 2302 del 27.03.1990.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute;

VISTA la legge regionale 31.12.1987, n. 64, concernente "norme per l'autorizzazione, la vigilanza, e le convenzioni con le case di cura private";

TENUTO CONTO delle note dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute del 9.1.96 prot. 179 e del 18.10.96 prot. 8869, trasmesse alle Aziende USL;

VISTA la legge 23.12.1994, n. 724, che prevede l'accreditamento provvisorio delle case di cura convenzionate al 31.12.1992, nelle more dell'eventuale accreditamento definitivo, per il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie costituisce presupposto indispensabile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14.1.1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

VISTA la propria deliberazione del 27.3.1990, n. 2302, con la quale la casa di cura "Rome American Hospital" sita in Roma - via E. Longoni, 69 gestita dalla Società "Rome American Hospital S.p.A.", con sede in Roma - via della Conciliazione, 10 - codice fiscale n. 07286860585 - Rappresentata da Catena Cornelio in qualità di Consigliere Delegato della Società, nato a New York (USA) il 1° agosto 1955, è stata autorizzata ad aprire e gestire la casa di cura privata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 64/87 per la tipologia Medico Chirurgica, e per la capacità ricettiva di n. 150 posti letto con annessi ambulatori;

VISTA la propria deliberazione del 30.7.1996 n. 6307 con la quale si aggiornava la precedente deliberazione di autorizzazione n. 2302/90 relativamente all'articolazione dei raggruppamenti e delle unità di degenza;

VISTA altresì la propria deliberazione del 31.7.1997 n. 4906 con la quale si è preso atto della sostituzione del Direttore Sanitario;

VISTO il nulla osta rilasciato dal Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA B con deliberazione n. 78CS DEL 1.9.1999 - pervenuta in data 8.9.1999 prot. 5315 - per la variazione della autorizzazione derivante dalla realizzazione di n. 2 nuove sale operatorie e di un servizio di Day-Surgery nei locali precedentemente destinati a Day - Hospital, corredato della seguente documentazione in duplice copia: Planimetrie, relazione tecnica, elenco del personale adibito al day surgery, elenco del personale adibito alle sale operatorie, pareri dei Servizi della Azienda USL (P.I.S.L.L. del 19.7.99, prot. n. 1340 - S.I.S.P. del 16.7.1999 prot. n. 1492);



VISTA la nota dell'assessorato Salvaguardia e Cura della Salute prot. n. 6148 del 21.10.1999, con la quale si richiede alla Azienda USL un supplemento di istruttoria ai fini della predisposizione del provvedimento di integrazione e modifica della autorizzazione;

VISTA la nota predisposta della Azienda USL ROMA B del 12.11.99 prot. n. 884, con la quale si forniscono chiarimenti in ordine al piano della struttura interessato alla modifica;

CONSIDERATO che l'Azienda USL ROMA B non ha provveduto a trasmettere ulteriore documentazione e che pertanto con la predetta nota ha confermato la precedente istruttoria;

RITENUTO di dover aggiornare la propria deliberazione n. 2302/90, provvedendo alla modifica e integrazione del punto 2) del dispositivo per quanto riguarda la attivazione di n. 2 nuove sale operatorie e di un servizio di day - surgery nei locali precedentemente destinati a day - hospital;

RITENUTO di dover prendere atto, quindi, che il servizio di day hospital è stato sostituito con il servizio di day surgery;

VISTA la legge del 15.5.1997, n. 127 art. 17;

All'unanimità,

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama:

- 1) Di prendere atto del nulla osta del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA B riguardante la casa di cura "Rome American Hospital" sita in Roma via E. Longoni, 69, relativo all'attivazione di n. 2 nuove sale operatorie e di un servizio di day-surgery nei locali precedentemente destinati a day-hospital, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione unitamente ai seguenti documenti:
 - tavola planimetrica (gruppo operatorio - piano primo edificio B)
 - relazione tecnica di progetto
 - elenco personale adibito al day surgery
 - elenco personale adibito alle sale operatorie
 - parere dei servizi.
- 2) Di modificare e integrare l'autorizzazione di cui alle proprie precedenti deliberazioni n. 2302 del 27.3.1990 e n. 6307 del 30.7.1996 - con particolare riferimento al punto 2) del dispositivo - come segue:
 - a) l'autorizzazione per l'attività riguardante "il servizio di day hospital attrezzato per n. 10 pazienti" deve intendersi sostituita con l'autorizzazione al funzionamento di "n. 2 nuove sale operatorie e del servizio di day-surgery".

Restano invariate le proprie precedenti deliberazioni n. 2302/90, n. 6307/96 e n. 4906/97 per quanto non modificato con la presente deliberazione.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge del 15.5.1997, n. 127 - art. 17.

IL PRESIDENTE : F. lo PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F. to Dott. Saverio GUCCIONE

27 MAR. 2008



AZIENDA SANITARIA LOCAL RM "B"

00157 Roma - Via Filippo Meda, 35 telefono 06/416011 - fax 41601220

Uslrmb@eureka.it

SITO INTERNET: <http://www.eureka.it/uslrm>

Unità Org.va. Vigilanza Strutture Sanitarie

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Maria Teresa Altana

Prot. n. 34579

Roma, 17 SET. 1999

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO SALVAGUARDIA
E CURA DELLA SALUTE

- 8 SET. 1999

N. DI PRCT. 5315
SET. 54

Assessorato Salvaguardia e
Cura della Salute
Regione Lazio - settore 54
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
145 Roma

Oggetto: Richiesta attività "Day Surgery" e realizzazione n.2 sale operatorie presso Casa di Cura "Rome American Hospital" - modifica decreto autorizzativo

Con riferimento all'oggetto, si trasmette per ulteriore seguito di competenza, copia della delibera n.78 CS del 1.9.'99 corredata della relativa documentazione.

Massimiani
17/9/99

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. A. Massimiani

1563

REGIONE LAZIO - ASSESSORATO SALVAGUARDIA E CURA DELLA SALUTE - SETTORE 54

[Signature]

[Handwritten mark]

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA "B"

Ufficio di Segreteria del Direttore Amministrativo

00157 - Roma - Via Filippo Meda n.35

Prot. n. 70

Roma 6.9.99

AIDE. ALIANA M. TERESA

Responsabile dell'Unità organizzativa

VIGILANZA STRUTTURE SANITARIE

Oggetto: Notifica deliberazioni del Commissario Straordinario .

Per l'ottemperanza si notificano le seguenti deliberazioni , regolarmente esecutive ai sensi della legge n.412/91 e della legge regionale n.18/94 :

- n. 786 del 1.9.99

- n. del

- n. del



d'ordine del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DELIBERE

[Handwritten signature]

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA "B"
Sede legale: 00157 - Roma - Via Filippo Meda n.35

N. 7805
Data 1-9-99

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO:

Attuazione art.4 della legge Regionale n.64/1987 . Realizzazione n.2 sale operatorie e attività day surgery presso la Casa di Cura Privata " Rome American Hospital".

PRESENTAZIONE SU CONTO

IN CAPITOLO _____

ESERCIZIO _____

N. _____

DATA _____

IL RESPONSABILE
UNITA' ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA - BILANCIO E
GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE



SPECIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PROPOSTA

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

IL RESPONSABILE DELLA
UNITA' ORGANIZZATIVA
AZIENDA U.S.L. ROMA B
U.O. AMMINISTRATIVO SAN.

[Signature]

Il Commissario Straordinario

L'anno millenovecentonovantanove il giorno 10 del mese di settembre, nella Sede legale dell'Azienda Unita' sanitaria locale Roma "B", sita in Roma - Via Filippo Meda n.35, il Commissario Straordinario Dr. Ernesto Peri, nominato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.3705 del 6.7.1999, assistito dai Direttori Amministrativo Dr. Angelo Massimiani e dal Direttore Sanitario Dr. Stefano Pompili, ha adottato la seguente deliberazione:

[Handwritten notes and signatures]

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RM/B

UNITA' ORGANIZZATIVA VIGILANZA STRUTTURE SANITARIE

Via Filippo Meda 35

000157 Roma

Prot. n° 651
Allegati

Roma, 20 - 7 - 88

Al Direttore Sanitario
Dr. Stefano Pompili

SEDE

Oggetto: Richiesta attività "day surgery" e realizzazione n.2 sale operatorie presso Casa di Cura "Rome American Hospital" - Modifica decreto autorizzativo

Con riferimento alla domanda presentata, sono stati effettuati i sopralluoghi di verifica, esaminata la documentazione trasmessa, acquisito i pareri dei Servizi competenti; sulla base di quanto accertato si ritiene di poter esprimere parere favorevole per n.2 sale operatorie collocate al primo piano- edificio B e per la realizzazione del day surgery (trasformazione dell'attività e degli spazi precedentemente autorizzati come day hospital).

Si prende atto, inoltre, che le due sale operatorie sono a disposizione del Libero Istituto Universitario Campus Biomedico.

Vengono allegati: n. 2 planimetrie
n. 2 relazioni tecniche
n. 2 elenco personale adibito al day surgery
n. 2 elenco personale adibito alle sale operatorie
n. 1 parere dei Servizi



Il Responsabile U.O.
Vigilanza Strutture Sanitarie
Dr.ssa Maria Teresa Altana

A large, handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Stefano Pompili, the Director of Health Services mentioned in the header.

AOU.SS. 660 del 22.7.99

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
"ROMA B"

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

via E. Franceschini 56 - Roma
tel. / fax 41601936

Servizio P.I.S.L.L.

Roma 19.7.99

Prot. n. 1340

Al Responsabile U.O. V.S.S.
Drsse R. T. Alfani

Oggetto: Parere del Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per la richiesta di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 64/87 della Casa di Cura "Rome American Hospital" - via E. Longoni 69.

In relazione alla richiesta di autorizzazione da parte della struttura in oggetto sono state verificate le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro senza riscontrare difformità. Si segnala la necessità, prima dell'inizio dell'attività, di presentare al servizio scrivente l'aggiornamento della certificazione relativa alla Prevenzione Incendi (richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di sopralluogo successivo all'approvazione del progetto delle modifiche apportate con l'installazione delle nuove sale operatorie al quinto piano).

Il Responsabile SPISLL
(Dr. Sergio Rovetta)



UOV. SS. 662
del 22.7.99

Azienda Sanitaria Locale RM/B
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Settore Strutture ed Attività Sanitarie
V.le E. Franceschini 56/B - 00155 Roma
Tel. (centralino) 416011 - fax 41601905

Prot. 1192/SISP del 16.7.99

U.O. Vigilanza Strutture
Sanitarie - ASL RM/B

E p.c. Rome American Hospital
Via E. Longoni 69
00155 Roma

Campus Bio Medico
Via E. Longoni 83
00155 Roma



SPISLL ASL RM/B - sede

Oggetto: richiesta modifica autorizzazione ex art. 4 L.R. 64/87, per la realizzazione di due nuove sale operatorie.

In risposta alla richiesta prot. ASL 7644 del 6/2/98 e alla successiva del 9/12/98, pervenuta dalla Casa di Cura "Rome American Hospital" per la realizzazione di un nuovo blocco operatorio, visti i requisiti indicati nella L.R. 64/87, ed essendo stata accertata, nel corso del sopralluogo effettuato in data 07/07/99 dal Responsabile del Settore Strutture Sanitarie, l'avvenuta separazione del locale preparazione chirurghi ed una migliore delimitazione della zona per la preparazione e il risveglio del paziente, come da nostra richiesta prot. 1162/IP/22925 del 2/6/99, si esprime parere favorevole per quanto riguarda il rilascio di autorizzazione regionale per la messa in attività delle due nuove sale operatorie.

Si allegano n. 5 copie delle planimetrie del nuovo complesso operatorio, come risultante dall'ultimo sopralluogo effettuato.

Il parere di competenza dello SPISLL verrà trasmesso autonomamente.

Il Campus Bio-Medico ed il Rome American Hospital, che leggono per conoscenza, per quanto di rispettiva competenza dovranno far pervenire allo scrivente Servizio, per la successiva vigilanza, i manuali riportanti le procedure ordinarie per il mantenimento dell'asepsi, ed i controlli periodici che, a tal fine, saranno effettuati sulle apparecchiature e l'ambiente.

Il responsabile del Settore Strutture Sanitarie
Dr. Fabrizio Magrelli

[Handwritten signature of Dr. Fabrizio Magrelli]

La Dirigente del S.I.S.P.
Dr.ssa Giufra Ausili

[Handwritten signature of Dr.ssa Giufra Ausili]





REGIONE LAZIO

Assessorato

Salvaguardia e Cura della Salute

Sett. 54/I-IV

Prot. n.

6148

Roma, li


21 OTT. 1999

RACCOMANDATA R.R.

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELLA AZIENDA USL ROMA B
Via Filippo Meda, 35
00157 ROMA

AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
CASA DI CURA PRIVATA
"ROME AMERICAN HOSPITAL"
Via E. Longoni, 69
00155 ROMA

Oggetto: Deliberazione Commissario Straordinario Azienda
USL ROMA B del 1.09.1999, n. 78:
"Autorizzazione art. 4 della Legge Regionale
n. 64/1987. Realizzazione n. 2 sale operatorie
e attività day surgery presso la Casa di cura
privata "ROME AMERICAN HOSPITAL".



Con riferimento alla nota del 7.09.1999, prot. n. 34579, con la quale la Azienda USL ha fatto pervenire la deliberazione di cui all'oggetto, si precisa quanto segue.

Ai fini della predisposizione del provvedimento regionale da sottoporre alla Giunta Regionale, per la modifica della autorizzazione rilasciata a suo tempo alla casa di cura in questione, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 31.12.1987, n. 64, è necessario che l'Azienda faccia pervenire ulteriori tre copie della documentazione, debitamente siglata, precisando se la modifica interessa solo il primo piano della struttura - come da planimetria - per la installazione di due nuove sale operatorie e la modifica del day hospital in day surgery ovvero anche il quinto piano, come evidenziato nel parere allegato, espresso dal Dipartimento di Prevenzione in data 19.07.1999, con nota prot. n. 1340, per quanto riguarda l'aggiornamento della certificazione relativa alla Prevenzione Incendi (richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di sopralluogo successivo all'approvazione del progetto delle modifiche apportate con l'installazione delle nuove sale operatorie al quinto piano).

Si fa notare, ad ogni buon fine, che la presentazione di documentazione integrativa, e parziale - e non la sostituzione di quella facente parte integrante e sostanziale dell'atto primario di autorizzazione al funzionamento della casa di cura - non facilitano la comprensione degli atti stessi, anche da parte degli organismi preposti alla vigilanza e al controllo.

IL DIRIGENTE
(Elda Melaragno)



MG16106

r-a-h

SCARICATO

54

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA "B"
Sede legale: Via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma - Centralino: 416011
Codice fiscale e Partita IVA: 04734201009
Indirizzo posta elettronica: Uslrmb@eureka.it - Sito internet: <http://www.eureka.it/uslrmb>

Unità Org. va Vigilanza Strutture Sanitarie

All. n.

Prot.n. 886

Roma, 12.11.99

Resp.le del Procedimento:
Dr.ssa Maria Teresa Altana

Via F. Meda, 35 - 1° Piano Stanza 16
Tel. 0641601614 206 - fax 41601220

REGIONE LAZIO	
ASSESSORATO SALVAGUARDIA E CURA DELLA SALUTE	
24 NOV. 1999	
N. di PROT.	6731
SETT.	54

REGIONE LAZIO
Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute
Settore 54/ I-IV

Oggetto: Deliberazione Commissario Straordinario Azienda USL Roma B del 1.09.1999, n.78:
"Autorizzazione art.4 della Legge Regionale n. 64/1987. Realizzazione n.2 sale operatorie
e attività day surgery presso la Casa di cura privata "ROME AMERICAN HOSPITAL".

Si fa riferimento a Vs. nota prot.6148 del 21 ottobre1999, pari oggetto, per rappresentare che la modifica richiesta interessa esclusivamente il primo piano, in quanto si è probabilmente incorsi in un errore di battitura (vedi nota del Servizio S.P.I.S.L.L. allegata). Si fa presente che inoltre presso la Casa di cura "ROME AMERICAN HOSPITAL" non esiste "un quinto piano" come deducibile dalle planimetrie facenti parte integrante del decreto autorizzativo a suo tempo rilasciato.

Maestri
29/11/99
1999

Il Responsabile U.O.
Vigilanza Strutture Sanitarie
Dr.ssa Maria Teresa Altana



[Faint handwritten signature]

LA. 879/00VSS
10.11.1999

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA B

Sede legale: Via Filippo Meda n.35 - 00157 - Roma; Centralino: 06416011

Codice Fiscale e Partita IVA : 04734201009

post elettronica : uslrm@eureka.it Sito Internet: <http://www.eureka.it/uslrm>

Dipartimento di Prevenzione - S.P.I.S.L.L.

Via E. Franceschini 56 - 00155 Roma tel. 06/41601946 fax 06/41601936

Roma 4/11/99

Prot. n. 1949.....

Al Responsabile dell'Unità Org.va
Vigilanza Strutture Sanitarie
Dr.ssa Maria Teresa Altana

Oggetto: Parere del Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per la richiesta di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 64/87 della Casa di Cura "Rome American Hospital" - via E. Longoni 69. Chiarimenti.

In relazione alla nostra comunicazione del 19/7/99 su quanto in oggetto si conferma il parere favorevole alla richiesta di modifica dell'autorizzazione, chiarendo che la dicitura riportata "nuove sale operatorie al quinto piano" reca un evidente errore, trattandosi di strutture collocate al primo piano dell'edificio B.

Ci scusiamo per quanto derivato dall'errore di battitura.

Il Responsabile SPISLL
(Dr. Sergio Rovetta)

Boru



2001/95/18
U.O.U.

RELAZIONE DI PROGETTO
PER LA REALIZZAZIONE DI SALE OPERATORIE
PRESSO IL
ROME AMERICAN HOSPITAL



ROME AMERICAN HOSPITAL S.p.A.
Via Emilio Longoni, 69
00155 ROMA
Partita IVA 01739301008

[Handwritten signature]



L'incremento continuo della nostra attività ci obbliga ad aumentare il numero delle Sale operatorie ed abbiamo pertanto individuato al primo piano della palazzina B, giusto adiacente al reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva, la possibilità di realizzare un blocco operatorio con n. 2 Sale operatorie.

Lo studio di progetto è obbligato al rispetto dei vincoli strutturali che sono:

- 1) Gli spazi disponibili e i metri quadrati che si trovano al 1° piano dell'attuale palazzina dove sono previste n. 2 Sale Operatorie, la Centrale di Sterilizzazione e le relative stanze di supporto.
- 2) Le scale e gli ascensori di accesso e di collegamento con gli altri piani.
- 3) I pilastri in cemento armato.
- 4) Il collegamento con percorsi per materiali puliti e sporchi.
- 5) Uscite di emergenza.



Nello sviluppo del progetto che interessa la realizzazione funzionale di un Blocco Operatorio con n. 2 Sale operatorie per chirurgia generale e specialistiche si è fatta particolare attenzione allo studio dei percorsi delle persone, dei pazienti e dei materiali con le relative zone filtro per garantire il massimo di efficienza ed operatività nel rispetto dei moderni concetti di sterilità e di prevenzione delle infezioni crociate in reparti così altamente specializzati.



La soluzione di importanti problemi quali il mantenimento costante della sterilità e la libera circolazione delle persone attorno al paziente, verrà realizzata sia nelle Sale Operatorie che nei locali di supporto con l'installazione a soffitto di adeguati sistemi pensili che, oltre a sostenere le molteplici apparecchiature sempre più presenti e necessarie per la moderna chirurgia, forniranno la distribuzione dei gas e delle prese elettriche lasciando libero il pavimento da apparecchiature, cavi, ecc. "Tutto quanto è possibile viene sollevato dal pavimento e tutto viene alimentato dall'alto" e le varie apparecchiature vengono posizionate nella migliore posizione ergonomica.



Inoltre il mantenimento costante della sterilità verrà garantito da un efficiente impianto di condizionamento d'aria che, oltre ai filtri assoluti, manterrà un gioco di pressioni differenziate partendo da pressioni più elevate nelle S.O.

La soluzione di un altro grande problema quale lo stoccaggio dei moltissimi materiali, per lo più monouso necessari nel routinario lavoro giornaliero, verrà risolto con l'installazione di una serie di armadi pensili a parete.




Nel blocco operatorio sono state elaborate le seguenti zone:

- a) filtro pazienti
- b) filtro personale
- c) sale operatorie
- d) preparazione chirurghi
- e) preparazione pazienti
- f) risveglio pazienti
- g) centrale di sterilizzazione
- h) sosta personale
- i) Capo Sala



- a) filtro pazienti: una grande finestra con sali/scendi separa la zona pulita da quella sporca ed una speciale barella con nastro a scorrimento automatico facilita il trasferimento del paziente in ingresso al Blocco Operatorio. Detta barella, posizionata all'interno del blocco operatorio, preleva il paziente in entrata dal suo letto e lo deposita sul tavolo operatorio. Dopo l'intervento chirurgico, preleva il paziente dal tavolo operatorio e lo deposita in uscita sul letto di Terapia Intensiva e/o letto di degenza.
- b) filtro personale: di sala operatoria suddiviso in due settori (per maschi e femmine) ciascuno dei quali fornito di: W.C., doccia, armadietti spogliatoi con chiave, panca di separazione pulito/sporco, deposito scarpe, deposito vestiario per Sala Operatoria....

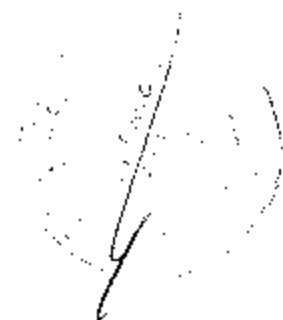

- c) sale operatorie: oltre ai sistemi pensili sono state previste anche pareti tecniche e un arrotondamento degli angoli in grado di accogliere la ripresa dell'aria condizionata per facilitare il ricircolo. Le porte delle sale operatorie saranno a funzionamento automatico per garantire il mantenimento di una pressione differenziata (vale a dire superiore all'interno delle sale operatorie rispetto all'esterno).
- d) preparazione chirurghi: due doppi lavelli adiacenti alle S.O. con distribuzione automatica di acqua sterile (con filtri altamente batteriologici)
- e) preparazione pazienti: vedi sotto
- f) risveglio pazienti: adiacenti alle S.O. con sistemi pensili per poter avere a disposizione prese gas medicali, prese elettriche e vassoi per il posizionamento delle apparecchiature.



- g) centrale di sterilizzazione: suddivisa in 2 zone distinte con diaframma formato da 2 autoclavi passanti (ingresso da area sporca e uscita verso area pulita)
- * zona di ingresso materiale sporco con banco di lavaggio e disinfezione dello strumento chirurgico sporco e area di preparazione pacchi per la sterilizzazione
 - * zona di uscita del materiale sterile dall'autoclave con area di stoccaggio materiale pulito e sterile.




UOV 274 22.3.99



Roma, 11 marzo 1999

VICIL



Alla Azienda USL RM/B
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Via Filippo Meda, 35
00157 - Roma

Alla c. a. della Dott.ssa Maria Teresa Altana

Oggetto: Modifica autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 64/87 - Trasmissione di informazioni.


Facendo seguito alla richiesta del 9.12.98 concernente la modifica della autorizzazione di cui alla deliberazioni della Giunta Regionale n. 2302/90 e n. 6307/96, e con riferimento alla richiesta di integrazione di informazioni avanzata dalla Commissione di codesta USL, in occasione della visita di sopralluogo effettuata in data 8.3.99, si trasmette in allegato alla presente:

- Elenco delle apparecchiature ed elenco del personale del Day Surgery;
- Elenco apparecchiature delle due nuove sale operatorie predisposto dal LIUCBM, cui le stesse sale operatorie sono destinate;
- Elenco del personale che opererà in dette due nuove sale operatorie predisposto dal LIUCBM.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni a riguardo, si porgono i migliori saluti.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Walter Regolo

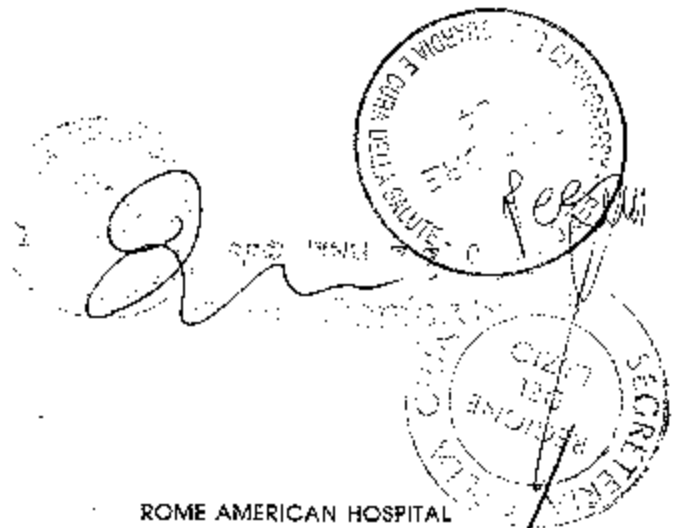

ROME AMERICAN HOSPITAL
Via Emilio Longoni, 69 - 00155 Roma
Tel.: 06/2255.1 - Fax: 06/2289062
Studi Medici: 06/2255290

ELENCO ATTREZZATURE DELLE DEL DAY SURGERY



Dipartimento : Day Surgery

Inventariofo	Civab	Apparecchio	Modello	Serie	Fornitore	Assistenza Tecnica
202	DEFKON04	DEFIBRILLATORE	504 HEARTSTATION	G5925	KONTRON INSTRUMENT	TEKMED
206	ACHAER35	ASPIRATORE MEDICO CHIRU	ASPIRATORE SAM 35	70204		
207	FLUOLY3E	FONTE LUMINOSA	CLK 3 E	7814778	LORENZATTO	SANIMED
208	FLUJOLY13	FONTE LUMINOSA	ILK-3	7923073		SANIMED
209	VIDFUJEV	VIDEOENDOSCOPIA, SYSTEM	EPX-301E	91289	VANNI	VANNI
210	VIDFUJEV	VIDEOENDOSCOPIA, SYSTEM	EPX-301E	101010	VANNI	VANNI
214	AUTESHL2	AUTOCLAVE	SES LITTLE SISTER 2	LSG0885-05		
251	POOAKR	POLTRONA OPERATORIA				
266	TOPSD52	TAVOLO OPERATORIO	OPMASTER 521	100299		
277	STEOLYC2	SYSTEMA TELEVISIO PER E	EVIS CV 200	7131464		SANIMED
278	FLUJOLY20	FONTE LUMINOSA	CLV U 20	7254836		SANIMED
279	FSEOLYTC	CARRELO SERVITORE PER	TC V1	7206208		SANIMED
281	CLSOLYDL	COLONSCOPIO	CF 200 HL	2110172		SANIMED
282	GFLOLY2C	GASTROSCOPIO	GIF Q200	2111024		SANIMED
283	DUSOLYJ2	DUODENOSCOPIO	TJF 200	2100100		SANIMED
284	LFSOLY20	LAVATRICE PER FIBROSCO	TD 20 LAVATRICE MANUALE			SANIMED
285	AUTESHL2	AUTOCLAVE	SES LITTLE SISTER 2	0889-01		
495	ELBESH40	ELETTROBISTURI	DS 402	2191	SEDA SRL	SEDA SRL
496	ELBESH40	ELETTROBISTURI	DS 402	2190		SEDA SRL
515	TOPESHM	TAVOLO OPERATORIO	MR SERIES	1067		
530	CRC3BE14	CRIOCHIRURGIA, APPARECC	142 CRYOUNIT	33176		
532	LOHCRH3P	LASER CHIRURGICO	XA 30 SP CO2	SL34-		



TECNOSALUS

ROME AMERICAN HOSPITAL

Dipartimento : Day Surgery

Inventario	Civab	Apparecchio	Modello	Serie	Fornitore	Assistenza Tecnica
533	SRMIOLX	STRUMENTAZIONE PER MIC	SITE TXR	1881214	ETHICON	ETHICON
541	MOPZES6F	MICROSCOPIO OPERATORI	OPMI 6 CFR	178265		MICRO SERVICE
543	MTVSOYK1	MONITOR TELEVISIVO PER B	KX 14CP1	5009545		SANIMED
562	STEOLYS2	SISTEMA TELEVISIVO PER E	OTV S2	2124338		DATEX OHMEDA
619	LEPCRK8T	MISURATORE AUTOMATICO	8100T DINMAP	811H1666		
Z1060	ACHOHMH	ASPIRATORE MEDICO CHIRU	HIGH CONT.SUCTION REGUL	GFHS08227	OHMEDA Spa	
Z1202	FSEDUE	CARRELLO SERVITORE PER		98762	DUEFFE srl	
Z1203	LSCBAOB4	LAMPADA SCIALITICA	BCM 4+1	7850928	BRANDON	
Z289	BRPOLYFP	BRONCOSCOPIO	BF P20	201673	LORENZATTO	SANIMED
Z291	LSCVN	LAMPADA SCIALITICA			VINCAL	VINCAL
Z292	KSCNTBK7	LAMPADA SCIALITICA	ML 701	200970492		
Z293	ORRSIT12	PRINTATRICE	UP 1200AEPM	21358	SONY MEDICAL	SONY MEDICAL
Z295	GFLOLYQ2	GASTROSCOPIO	GIF Q20	100704	OLYMPUS	SANIMED
Z297	296 GLSOLYHL	COLONSCOPIO	CF 20HL	2021271	OLYMPUS	SANIMED
Z298	FLUOLYK4	FRONTE LUMINOSA	CLK 4	7001096	OLYMPUS	SANIMED
Z298	ELBALSMB	ELETTROBISTURI	ALSATOM MB1	351	OLYMPUS	
Z558	AFUESHSM	ASPIRATORE FUMI LASER	SMOKE UNIT	0020	ESCHMANN BROS AND	SEDA SPA



PERSONALE DAY SURGERY ROME AMERICAN HOSPITAL

ABBATI MARCO	INFER. PROF.
BEU STEFANA	INFER. PROF.
CENTO ILENO	INFER. PROF.
CIFONELLI ELISABETTA	INFER. PROF.
DI RUZZA BARBARA	INFER. PROF.
MARAZZI ANNA MARIA	INFER. PROF.
NARDI FABIOLA	INFER. PROF.
SPADACCINI DIANA FRANCES	INFER. PROF.
SANTANELLI GIUSEPPINA	AUSILIARIA



ELENCO ATTREZZATURE DELLE DUE NUOVE SALE OPERATORIE
PIANO 1°




IDB	Cl	s.Cl	A	Cdc	PRG	E	Locale di destinazione	Descrizione	Modello	ID Costruttore	Numero di Serie	n° pos.
2	01	1			032	2	C.O. Chir. Gen.	Adattatore per reggibacchi speciali Stille	150-050	N.G.C.		139/10
2	00	0			104	2	Sterilizzazione	Adduttore automatico di acqua		N.G.C.		128
2	01	1			030	2	C.O. Chir. Gen.	Appoggio laterale toracico con cuscino		N.G.C.		
2	01	1			029	2	C.O. Chir. Gen.	Appoggio laterale toracico con cuscino		N.G.C.		
2	01	1			027	2	C.O. Chir. Gen.	Arco di supporto reggibacchi per pos. laterale	100-210	N.G.C.		139/12
2	01	1			008	2	C.O. Chir. Gen.	Arconarcosi completo di morsetto ed estensile	100-110/112	N.G.C.		139/1
2	01	1			010	2	C.O. Cardio	Arconarcosi completo di morsetto ed estensile	100-110/112	N.G.C.		139/1
2	01	0			109	2	Sterilizzazione	Armadio in acciaio inox bilfronte per strumentario sterile	100x60x200	N.G.C.		130
2	01	0			110	2	Sterilizzazione	Armadio in acciaio inox bilfronte per strumentario sterile	100x60x200	N.G.C.		150
3	90	0			127	2	Capo Sala	Armadio portafarmaci finali 2 ante 67x60x200		N.G.C.		105
3	90	0			133	2	Capo Sala	Armadio servizio 2 ante 100x45x200		N.G.C.		106
3	90	0			134	2	Capo Sala	Armadio servizio 2 ante 90x45x200		N.G.C.		107
3	90	0			120	2	Spogliatoio uomini	Armadio spogliatoio 14 posti: 175x40x280		N.G.C.		112
3	90	0			121	2	Spogliatoio donne	Armadio spogliatoio 14 posti: 175x40x280		N.G.C.		112
2	01	1			150	2	C.O. Chir. Gen.	Asta disseasamento reggibacchi per adulti		N.G.C.		139/
2	01	1			151	2	C.O. Chir. Gen.	Asta disseasamento reggibacchi per bambini		N.G.C.		139/
2	01	1			142	2	C.O. Chir. Gen.	Asta radiotrasparente per controtrazione		N.G.C.		
2	01	1			143	2	C.O. Chir. Gen.	Asta reggibacchi radiotrasparente con cuscini		N.G.C.		
2	01	1			144	2	C.O. Chir. Gen.	Asta reggibacchi radiotrasparente con cuscini		N.G.C.		
2	01	1			145	2	C.O. Chir. Gen.	Asta reggibacchi radiotrasparente con cuscini		N.G.C.		
2	01	1			146	2	C.O. Chir. Gen.	Asta reggibacchi radiotrasparente con cuscini		N.G.C.		
2	00	0			103	2	Sterilizzazione	Autoclave aut. di sterilizzazione con camera cm45x65x100(1202) con ge		OMASA		126
2	00	0			102	2	Sterilizzazione	Autoclave aut. di sterilizzazione con camera cm64x64x100(1410) con ge		OMASA		125
2	00	0			097	2	Prep/Risv paziente	Banco con lavello e rubinetteria con due vani: 190x60x80		N.G.C.		109
2	00	0			120	2	Capo Sala	Banco controllo 210x60x80		N.G.C.		103
2	00	0			112	2	Traffamento materiali	Banco lavoro con lavello, vasca a getti con coperchio, rubinetteria, tre an		N.G.C.		122
2	00	0			002	2	C.O. Cardio	Barella di trasferimento tavolo operatorio		N.G.C.		139/
2	00	0			136	2	C.O. Chir. Gen.	Barella di trasferimento tavolo operatorio		N.G.C.		139/
2	00	0			003	2	Prep/Risv paziente	Barella di trasferimento tavolo operatorio		N.G.C.		139/
2	00	0			137	2	Prep/Risv paziente	Barella di trasferimento tavolo operatorio		N.G.C.		139/
2	01	1			105	2	Sterilizzazione	Carrelli per carico e scarico autoclave 100x50		N.G.C.		129
2	01	1			106	2	Sterilizzazione	Carrelli per carico e scarico autoclave 100x50		N.G.C.		129
2	01	1			107	2	Sterilizzazione	Carrelli per carico e scarico autoclave piccoli		N.G.C.		129
2	01	1			108	2	Sterilizzazione	Carrelli per carico e scarico autoclave piccoli		N.G.C.		129
2	01	1			004	2	comune	Carrello accessor	120-500	N.G.C.		138/17
2	01	1			063	2	C.O. Chir. Gen.	Carrello con vasca per scaldafisiologica		D. LUCINI	4104	149
2	01	1			062	2	C.O. Cardio	Carrello con vasca per scaldafisiologica		D. LUCINI	4105	149
2	01	1			053	2	Traffamento materiali	Carrello di servizio a due ripiani in acciaio inox		N.G.C.		124
2	01	1			054	2	Traffamento materiali	Carrello di servizio a due ripiani in acciaio inox		N.G.C.		124
2	01	1			055	2	Traffamento materiali	Carrello di servizio a due ripiani in acciaio inox		N.G.C.		124
2	01	1			056	2	C.O. Chir. Gen.	Carrello di servizio a due ripiani in acciaio inox		N.G.C.		124
2	01	1			057	2	C.O. Cardio	Carrello di servizio a due ripiani in acciaio inox		N.G.C.		124
2	01	1			074	2	C.O. Chir. Gen.	Carrello per anestesista in acciaio inox: 70x55x87		N.G.C.		152



2	01	1	073	2	C.O. Cardiol	Carrello per anestesista in acciaio inox, 70x65x97	N.G.C.	152
2	01	1	075	2	C.O. Cardiol	Carrello per perfusionista in acciaio inox	N.G.C.	163
2	01	1	081	2	C.O. Chir. Gen.	Carrello per strumentario a due ripiani in acciaio inox	N.G.C.	147
2	01	1	080	2	C.O. Cardiol	Carrello per strumentario a due ripiani in acciaio inox	N.G.C.	147
2	00	0	086	2	C.O. Chir. Gen.	Carrello portasacco	N.G.C.	150
2	00	0	087	2	C.O. Chir. Gen.	Carrello portasacco	N.G.C.	150
2	00	0	088	2	C.O. Cardiol	Carrello portasacco	N.G.C.	150
2	00	0	089	2	C.O. Cardiol	Carrello portasacco	N.G.C.	150
2	00	0	094	2	Spogliatoio uomini	Carrello portasacco con maniglione	N.G.C.	114
2	00	0	095	2	Spogliatoio donne	Carrello portasacco con maniglione	N.G.C.	114
2	00	0	058	2	C.O. Chir. Gen.	Carrello servitore idraulico	N.G.C.	148
2	00	0	059	2	Laboratorio Analisi	Carrello servitore idraulico	N.G.C.	148
2	01	1	011	2	C.O. Chir. Gen.	Ginghia antistatica fermapolsi con morsetto	N.G.C.	148
2	01	1	012	2	C.O. Chir. Gen.	Ginghia antistatica fermapolsi con morsetto	N.G.C.	139/8
2	01	1	013	2	C.O. Cardiol	Ginghia antistatica fermapolsi con morsetto	N.G.C.	139/8
2	01	1	014	2	C.O. Cardiol	Ginghia antistatica fermapolsi con morsetto	N.G.C.	139/8
2	01	1	138	2	C.O. Chir. Gen.	Ginghia ferma gambe con fascia imbottita	N.G.C.	139/8
2	01	1	139	2	C.O. Cardiol	Ginghia ferma gambe con fascia imbottita	N.G.C.	139/8
2	01	1	091	2	Pre/Risv paziente	Contentori per cateteri, con provettone sterilizzabile, sifita e morsetto a s	N.G.C.	139/3
2	01	1	092	2	Pre/Risv paziente	Contentori per cateteri, con provettone sterilizzabile, sifita e morsetto a s	N.G.C.	166/2
2	01	1	093	2	Pre/Risv paziente	Contentori per cateteri, con provettone sterilizzabile, sifita e morsetto a s	N.G.C.	166/2
2	01	1	023	2	C.O. Cardiol	Dispositivo movimenti in emergenza	N.G.C.	139/
2	01	1	024	2	C.O. Chir. Gen.	Dispositivo movimenti in emergenza	N.G.C.	139/
2	01	1	022	2	C.O. Chir. Gen.	Dispositivo di controllo a pedale	N.G.C.	139/16
2	01	1	026	2	C.O. Chir. Gen.	Estensione con piano per chirurgia della man	N.G.C.	139/23
2	01	0	129	2	Zona frigoemoteca	Frigoemoteca 96 sacche acciaio inox	Fiocchetti	101
2	01	0	130	2	Zona frigoemoteca	Frigorifero per farmaci a 2 temperature	Fiocchetti	102
2	01	1	025	2	C.O. Chir. Gen.	Gruppo estensore gambe per interventi ortopi	N.G.C.	139/19
2	01	0	100	2	Corridolo sporco	Gruppo sanitario a banco con lavapadelle, vuotatolo e lavello (disinfezior	N.G.C.	170
2	01	0	076	2	C.O. Cardiol	Lampada frontale Quadrifite a luce fredda cor	N.G.C.	158
2	01	0	077	2	C.O. Cardiol	Lampada frontale Quadrifite a luce fredda cor	N.G.C.	158
2	01	0	037	2	C.O. Chir. Gen.	Lampada scialitica a due cupole multifaro, luce fredda tipo a 130000 lux	AMSCO	140
2	01	0	036	2	C.O. Cardiol	Lampada scialitica a due cupole multifaro, luce fredda, fino a 130000 lu	AMSCO	140
2	01	0	111	2	Trattamento materiali	Lavastrumenti automatica con accessori	SMEG	120
2	00	0	084	2	Lavaggio chirurgi	Lavello 2 posti in acciaio inox con rubinetteria ut.	N.G.C.	136
2	00	0	085	2	Lavaggio chirurgi	Lavello 2 posti in acciaio inox con rubinetteria ut.	N.G.C.	136
3	90	0	118	2	Filtro uomini	Mobile servizio per biancheria sterile; 200x50x200	N.G.C.	117
3	90	0	119	2	Filtro donna	Mobile servizio per biancheria sterile; 200x50x200	N.G.C.	117
2	00	0	098	2	Relax Chirurgi	Modulo cucina: lavello, rubinetteria, miscelatore, fornello elettrico a due	N.G.C.	135
2	00	0	131	2	Prep/Risv paziente	Modulo di servizio con lavello, rubinetteria, ante, cassettiere serie Combi	N.G.C.	168
2	01	0	028	2	C.O. Chir. Gen.	Modulo divisorio con finestra saliscendi per trasferimento pazienti	N.G.C.	134
2	01	1	122	2	Filtro uomini	Morsetto per arco di supporto, 100.210	N.G.C.	139/13
2	00	0	122	2	Filtro uomini	Panca divisoria; 145x60x60	N.G.C.	115
3	90	0	123	2	Filtro donna	Panca divisoria; 145x60x60	N.G.C.	115



2	01	0	048	2	C.O. Cardio	Paralela tecnica attrezzata serie Comblasyt a 2 unità con orologio, negativo	N.G.C.	44
2	01	0	049	2	C.O. Chir. Gen.	Paralela tecnica attrezzata serie Comblasyt a due unità con orologio, negati	N.G.C.	14
3	90	0	089	2	Prep/Risv paziente	Pensile a 4 ante e ripiani, 190x35x100	N.G.C.	110
3	90	0	101	2	Corridoi sporco	Pensile in acciaio inox a due ante, 135x40x80	N.G.C.	171
2	01	0	113	2	Treatmento materiali	Pensile inox, 320x40x80	N.G.C.	123
2	01	0	045	2	Prep/Risv paziente	Pensile orientabile ad un braccio con due ripiani, completo di servizi elet	PMLD998111	88
2	01	0	046	2	Prep/Risv paziente	Pensile orientabile ad un braccio con due ripiani, completo di servizi elet	PMLD998109	88
2	01	0	047	2	Prep/Risv paziente	Pensile orientabile ad un braccio con due ripiani, completo di servizi elet	PMLD998110	88
2	01	0	043	2	C.O. Cardio	Pensile orientabile ad un braccio per monitor TV a circuito chiuso	PMLD998113	143
2	01	0	044	2	Cam. Op. Chir. Gen.	Pensile orientabile ad un braccio per monitor TV a circuito chiuso	PMPD998112	43
2	01	0	038	2	C.O. Cardio	Pensile per anestesia con due bracci, due piani orientabili, otto prese e	PMPD998129	141
2	01	0	039	2	C.O. Chir. Gen.	Pensile per anestesia con due bracci, due ripiani, otto prese elettriche,	PMPD998128	141
2	01	0	042	2	C.O. Chir. Gen.	Pensile per chirurgo con due bracci, due ripiani, otto prese elettriche, 8	PMPD998126	142
2	01	0	041	2	C.O. Cardio	Pensile per chirurgo con due bracci a compasso, otto prese elettriche, ott	N.G.C.	142
2	00	1	125	2	Relax Chirurgi	Pensile per cucina con vano scolapiatti e ripiani interni in acciaio inox;	N.G.C.	137
2	01	0	114	2	C.O. Cardio	Piano di appoggio interno alla sala operatoria in acciaio inox con armadie	N.G.C.	131/132/13
2	01	0	070	2	C.O. Chir. Gen.	Piantana su ruote con basamento a 5 razze con asta a due ganci	N.G.C.	151
2	01	0	071	2	C.O. Chir. Gen.	Piantana su ruote con basamento a 5 razze con asta a due ganci	N.G.C.	151
2	01	0	072	2	C.O. Cardio	Piantana su ruote con basamento a 5 razze e asta a due ganci	N.G.C.	151
2	01	0	073	2	C.O. Cardio	Piantana su ruote con basamento a 5 razze e asta a due ganci	N.G.C.	151
2	01	1	021	2	C.O. Chir. Gen.	Pinza fermedita	Weinberger	
3	92	0	128	2	Capo Sala	Poltroncina con braccioli	N.G.C.	104
2	01	1	116	2	Filtro uomini	Rastrelliera a muro in acciaio inox per mascherine, calzari, cappellini	N.G.C.	116
2	01	1	117	2	Filtro donne	Rastrelliera a muro in acciaio inox per mascherine, calzari, cappellini	N.G.C.	116
2	01	1	005	2	C.O. Cardio	Reggibraccio orientabile con cuscino anisiat	N.G.C.	139/4
2	01	1	006	2	C.O. Chir. Gen.	Reggibraccio orientabile con cuscino anisiat	N.G.C.	139/4
2	01	1	007	2	C.O. Cardio	Reggibraccio orientabile per anestesia con a	N.G.C.	139/4
2	01	1	008	2	C.O. Chir. Gen.	Reggibraccio orientabile per anestesia con a	N.G.C.	139/4
2	01	1	015	2	C.O. Cardio	Reggispalle con due morsetti	N.G.C.	139/6
2	01	1	016	2	C.O. Cardio	Reggispalle con due morsetti	N.G.C.	139/6
2	01	1	017	2	C.O. Chir. Gen.	Reggispalle con due morsetti	N.G.C.	139/6
2	01	1	018	2	C.O. Chir. Gen.	Reggispalle con due morsetti	N.G.C.	139/6
2	01	1	140	2	C.O. Chir. Gen.	Reggispalle con due morsetti	N.G.C.	139/6
2	01	1	141	2	C.O. Chir. Gen.	Reggitesta (parte a) per broncoscopia e Intex	N.G.C.	139/6
2	01	1	019	2	C.O. Chir. Gen.	Reggitesta (parte b) per broncoscopia e Interventi ENT	N.G.C.	139/6
2	01	1	033	2	C.O. Chir. Gen.	Scaproncini (pelo) per adulti	N.G.C.	139/11
3	92	0	115	2	Relax Chirurgi	Sedile a sbarra 3 posti con tavolino fisso	N.G.C.	139
3	01	0	050	2	C.O. Chir. Gen.	Sedile gas spring per anestesia	N.G.C.	172
3	01	0	051	2	C.O. Cardio	Sedile gas spring per anestesia-perfusionista	N.G.C.	146
3	01	0	052	2	C.O. Cardio	Sedile gas spring per anestesia-perfusionista	N.G.C.	146
2	00	1	094	2	Prep/Risv paziente	Sistema di aspirazione con vaso di raccolta, regolazione 0-760mm/Hg.	DAMECA	166/1
2	00	1	095	2	Prep/Risv paziente	Sistema di aspirazione con vaso di raccolta, regolazione 0-760mm/Hg.	DAMECA	166/1
2	00	1	096	2	Prep/Risv paziente	Sistema di aspirazione con vaso di raccolta, regolazione 0-760mm/Hg.	DAMECA	166/1
2	01	1	147	2	C.O. Chir. Gen.	Spazio reggibraccio radiotrasparenti (grande)	N.G.C.	156/1





2	01	1	148	2	C.O. Chir. Gen.	Spalbia reggibacino radiotrasparenti (piccola)	N.G.C.	
2	01	0	156		C.O. Chir. Gen.	Stazione mobile di emergenza		
2	01	0	157		C.O. Cardiol	Stazione mobile di emergenza		139/
2	01	1	152		C.O. Chir. Gen.	Supporto disassamento reggibacino per adulti	N.G.C.	139/
2	01	1	153		C.O. Chir. Gen.	Supporto disassamento reggibacino per bambini	N.G.C.	139/
2	01	1	158	2	C.O. Cardiol	Supporto laterale con morsetto	100-165/101	139/5
2	01	1	157	2	C.O. Cardiol	Supporto laterale con morsetto	100-165/101	139/5
2	01	1	031	2	C.O. Chir. Gen.	Supporto per artroscopia con cuscin	100-253	139/21
2	01	1	149		C.O. Chir. Gen.	Supporto reggibacino	N.G.C.	139/
2	01	1	020	2	C.O. Chir. Gen.	Tavoletta reggibacino	N.G.C.	
2	01	1	001	2	C.O. Cardiol	Tavolo operatorio con piani asportabili completi	K3 NGIC	1130
2	01	1	040	2	C.O. Chir. Gen.	Tavolo operatorio con piani esportabili con 2	K3 NGIC	1120
2	00	0		2	arriva 1/3/99	Termosaltatrice	OPT	139
2	00	0	088	2	Prep/Risv paziente	Unità di ossigenoterapia, umidificazione con contenitori di acqua sterile,	N.G.C.	121
2	00	0	089	2	Prep/Risv paziente	Unità di ossigenoterapia, umidificazione con contenitori di acqua sterile,	N.G.C.	166/3
2	00	0	090	2	Prep/Risv paziente	Unità di ossigenoterapia, umidificazione con contenitori di acqua sterile,	N.G.C.	166/3
2	01	1	034	2	C.O. Cardiol	Vassolo porta cassetta per lastre	N.G.C.	139/7
2	01	1	035	2	C.O. Chir. Gen.	Vassolo porta cassetta per lastre	N.G.C.	139/7
2	01	1	154		C.O. Chir. Gen.	Zampale per adulti	N.G.C.	139/
2	01	1	155		C.O. Chir. Gen.	Zampale per bambini	N.G.C.	139/





FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
POLICLINICO UNIVERSITARIO

Roma, 8 marzo 1999

BLOCCO OPERATORIO POLICLINICO CAMPUS BIO-MEDICO

Rossana	Grande	Caposala Sala Operatoria
Barbara	Cecarini	I.P. Ferrista
Teresa	Cuccuru	I.P. Ferrista
Francesca	Donati	I.P. Ferrista
Rosella	Graziani	I.P. Ferrista
Natascia	Loiello	I.P. Ferrista
Catia	Lupinetti	I.P. Ferrista
Chiara	Martucci	I.P. Ferrista
Ombretta	Mazzaroni	I.P. Ferrista
Federica	Orlando	I.P. Ferrista
Cristiana	Pellegrino	I.P. Ferrista
Katia	Stopponi	I.P. Ferrista
Patrizia	Tiberia	I.P. Ferrista
Belinda	Vedovi	I.P. Ferrista
Giovanna	Ancidei	I.P. Anestesia
Lucia	Gianotti	I.P. Anestesia
Elena	Pasqualotto	I.P. Anestesia
Delia	Grazzini	I.P. Ferrista
Claudia	Orsaia	I.P. Ferrista
Marisol	Bocanegra	I.P. Ferrista
Antonella	Ricciardi	I.P. Ferrista
Elisabetta	Averna	I.P. Day Surgery
Elisa	Fenizia	I.P. Day Surgery
Alessandro	Acciaresi	Ausiliario/Portantino
Francesco	Verga	Ausiliario/Portantino
Gianfranco	Fusco	Ausiliario
Gianfranco	Farris	Ausiliario/Portantino
Matteo	Ferraro	Ausiliario/Portantino
Roberto	Reis	Ausiliario/Portantino
Stefano	Correani	Ausiliario/Portantino

Il Direttore Sanitario
Dot. Lorenzo Cammelli

