

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 agosto 2004

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Reg. stampa Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2004, n. 319.

Istituzione presso le ASL di un servizio sperimentale di riutilizzo dei dispositivi medici di cui all'elenco 2 e 3 del DMS n. 332/99. «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe»

Pag. 3

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 APR. 2004

ADDI 23 APR. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDENI
.....COMISSIS

ASSENTI: FORMISANO, GARGANO, IANNARILLI, ROBILOTTA, VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. -319-

OGGETTO:

Istituzione presso le ASL di un servizio sperimentale di riutilizzo dei dispositivi medici di cui all'elenco 2e3 del DMS 332/99 " regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN : modalità di erogazione e tariffe" 



319 23 APR. 2004

OGGETTO: Istituzione presso le ASL di un servizio sperimentale dei dispositivi medici di cui all'elenco 2 e 3 del DMS 332/99 "regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le politiche per la famiglia e servizi sociali, di concerto con l'Assessore per la Sanità;

VISTO l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente "Istituzione del servizio sanitario nazionale;

VISTO l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n° 46 concernente l'attuazione della direttiva 99/42/CEE riguardante dispositivi medici;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 concernente "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nei quali viene ricompresa l'assistenza protesica e quindi la fornitura di protesi, ortesi ed ausili tecnici ai disabili;

VISTO il decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 concernente "Regolamento recante norme per la prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe"

VISTO in particolare l'art. 4, comma 12 del DM 332/1999, che prevede la facoltà per le Regioni, allo scopo di conseguire economie di gestione, di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi di cui all'elenco 1 e 2 per cui sia possibile il riutilizzo, prevedendo comunque l'obbligo dell'azienda ASL cedente, di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi e di fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente;

VISTA la ^{DCR}~~DGR~~ 31 luglio 2002 n.114 "Indirizzi per la programmazione Sanitaria Regionale per il triennio 2002/2004 - PSR

VISTO il Piano sanitario nazionale triennio 2003/2005 approvato con DPR 28/05/2003;

VALUTATA l'opportunità, al fine di consentire l'istituzione a livello di singola ASL di un servizio di riutilizzo, di avvalersi della facoltà ex articolo 4, comma 12, DM 332/1999 di individuare una serie di presidi contenuti nell'elenco 2 allegato al decreto stesso da concedere in comodato;

RITENUTO altresì di individuare una serie di presidi nell'ambito dell'elenco 2 e 3 allegato al DM 332/1999 per il servizio di riutilizzo;



319 23 APR. 2004

6



CONSIDERATO che il servizio di riutilizzo dei presidi protesici si propone di rispondere, con tempestività, al bisogno di ausili all'utenza al fine di consentire interventi riabilitativi ed assistenziali residenziali e/o domiciliari efficaci e inoltre di ottenere un razionale ed economico utilizzo delle risorse;

TENUTO CONTO che gli aventi diritto al servizio di riutilizzo sono elencati all'articolo 2 del D.M.S. 332/99 limitatamente al comma c al comma e, e in tutti i casi ove ricorrano tali condizioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 370 del 2001 con il quale è stata integrata la Commissione tecnica di cui alla Deliberazione n. 4280 /96;

VISTO l'art. 10 del dm 332/1999 in virtù del quale deve essere attivato da parte di ciascuna ASI, un sistema di controllo interno ed esterno sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel suddetto regolamento;

RILEVATO che è stato istituito un gruppo di lavoro costituito da figure professionali facenti parte della succitata Commissione tecnica, al fine della individuazione delle modalità di cessione in comodato e della tipologia dei dispositivi per l'attuazione del servizio di riutilizzo;

VISTA la proposta di accordo tra la Regione Lazio e le Associazioni FIOTO, FEDERSAN, FEDERLAZIO e ARHEA, rappresentative delle aziende fornitrici dei dispositivi di cui al DM. 332/1999 che viene allegato e forma parte integrante, che contiene:

- a) le modalità ed i criteri per l'effettuazione del servizio di riutilizzo;
- b) l'individuazione nell'ambito degli elenchi 2 e 3 del d.m. 332/1999 dei dispositivi medici per il servizio di riutilizzo;

PRESO ATTO che le Associazioni hanno manifestato una preadesione alla succitata proposta di accordo;

Esperita la procedura di concertazione *con le parti sociali* ..

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa:

A) di approvare la proposta di accordo tra la Regione Lazio e le Associazioni FIOTO, FEDERSAN, FEDERLAZIO e ARHEA, rappresentative delle aziende fornitrici dei dispositivi di cui al DMS. 332/1999 che viene allegato (allegato 1) e forma parte integrante della presente deliberazione, relativo alla disciplina del servizio di riutilizzo dei dispositivi medici di cui agli elenchi 2 e 3 del decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332. Il protocollo d'intesa individua:

- 1) le modalità ed i criteri per l'effettuazione del servizio di riutilizzo e l'erogazione dei relativi dispositivi;
- 2) i dispositivi medici individuati all'interno degli elenchi 2 e 3 del DMS 332/1999 oggetto del riutilizzo;

M



[Signature] 2

31978 APR. 2004 9

B) di dare al Direttore del Dipartimento Sociale mandato per la firma dell'accordo di cui al punto A;

di istituire presso ogni azienda sanitaria locale, in via sperimentale e per un periodo di due anni dalla pubblicazione dell'allegato accordo, il servizio di riutilizzo dei dispositivi medici di cui all'elenco 2 e 3 del DMS 332/99, individuati nell'accordo di cui alla lettera A;

Le AUSL, nell'atto di autorizzazione di fornitura dei presidi individuati nell'accordo di cui alla lettera A

devono:

- 1) indicare espressamente che il presidio è concesso in comodato d'uso, secondo i termini di legge (art. 1803 e ss. C. c.);
- 2) far sottoscrivere, all'assistito o a chi lo rappresenta, l'impegno di restituzione del presidio quando non ricorrano più le necessità dell'uso.

E) Di stabilire che le ditte che aderiranno all'accordo allegato e parte integrante alla presente deliberazione, dovranno essere iscritte in un apposito elenco che sarà istituito presso le ASL secondo le modalità indicate dalle stesse

F) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. *ff*

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



ALLEG. alla DELIB. N. 319

DEL 23 APR 2004

Allegato I

ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA E AI SERVIZI SOCIALI

DIPARTIMENTO SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RIUTILIZZO
DEI DISPOSITIVI MEDICI DI CUI AGLI ELENCHI 2 e 3 DMS 332/99
TRA LA REGIONE LAZIO ED LE ASSOCIAZIONI FIOTO, FEDERSAN, FEDERLAZIO E
ARHEA DELLE AZIENDE FORNITRICI DEI DISPOSITIVI

- VISTO l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente "Istituzione del servizio sanitario nazionale;
- VISTO l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 concernente "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nei quali viene ricompresa l'assistenza protesica e quindi la fornitura di protesi, ortesi ed ausili tecnici ai disabili;
- VISTO il DM 332/99 concernente il "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione".

Tutto ciò premesso

TRA

LA REGIONE LAZIO e LE ASSOCIAZIONI FIOTO, FEDERSAN, FEDERLAZIO E ARHEA
FORNITRICI DEI DISPOSITIVI DI CUI ALL'ELENCO 2 E 3 DEL DECRETO DEL
MINISTERO DELLA SANITA' 332/1999



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. La Regione Lazio, attraverso le aziende sanitarie locali, istituisce in via sperimentale, per un periodo di due anni e partendo dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (sottoscrizione del presente accordo), un servizio di riutilizzo dei dispositivi di cui all'elenco 2 e 3 del decreto del Ministero della Sanità n. 332/1999, individuati nella Tabella A che viene allegata e costituisce parte integrante del presente accordo

Art. 2

2. Le Aziende Sanitarie della Regione Lazio istituiscono un archivio informatico per la gestione del magazzino ausili ed eventuale messa in rete della banca dati relativa agli ausili in uso tutto ciò al fine di monitorare la disponibilità degli ausili per la cessione in comodato d'uso.

Art. 3

1. La tariffa rimborsata dalla ASL all'Azienda erogatrice del servizio di riutilizzo di cui all'art.3 è suddivisa in una quota fissa pari ad EURO 40,00 + IVA comprendente ritiro a domicilio, sanificazione, igienizzazione, stoccaggio, immagazzinaggio, riconsegna o eventuale rottamazione e di una quota variabile in funzione al tipo di dispositivo da riutilizzare e alle parti da sostituire siano esse obbligatorie o facoltative come da schede iconografiche relative a ciascun dispositivo, allegata e facenti parte integrante alla presente deliberazione

Art. 4

1. Le modalità di attuazione del servizio di riutilizzo dei dispositivi di cui alla Tabella A sono le seguenti:
- a) le forniture agli aventi diritto sono effettuate sulla base della prescrizione del medico specialista e seguono lo stesso iter degli ausili nuovi;
 - b) ciascun dispositivo è identificato attraverso un'apposita scheda iconografica del dispositivo che deve contenere l'immagine dell'ausilio e dei suoi accessori con precise indicazioni dei codici di riferimento e la descrizione delle caratteristiche tecniche, delle misure e del peso.
In ogni scheda sono altresì indicate: data, modalità di erogazione funzioni peculiari, indicazioni d'uso, procedure per l'eventuale riutilizzo del dispositivo illisurato e costo del servizio comprendente i vari passaggi descritti al comma 2.
 - c) l'azienda erogatrice aderente al servizio di riutilizzo è tenuta a far pervenire alla ASL la scheda iconografica di cui al punto b, sia per i nuovi dispositivi identificati come riutilizzabili, sia per quelli in riutilizzo.
 - d) La gestione dell'archivio relativo alle schede iconografiche è di competenza della ASL proprietaria dei dispositivi ceduti in comodato.
2. Il servizio di riutilizzo dei dispositivi viene effettuato rispettando i seguenti passaggi:
- a) ritiro del dispositivo su mandato scritto da parte della ASL presso il domicilio dell'assistito entro 4 gg. dalla segnalazione. La ASL

incarica con mandato scritto la stessa azienda che ha provveduto alla prima fornitura.

Se l'azienda che ha effettuato la prima fornitura non ha provveduto ad accettare espressamente le modalità di cui al presente accordo, viene incaricata altra azienda fornitrice individuata dalla AUSL, tra quelle Aziende ortopediche aderenti al servizio di riutilizzo, operante nell'ambito del distretto della ASL di competenza.

La AUSL procede all'assegnazione di un dispositivo nuovo solo nel caso in cui nell'inventario dell'AUSL non siano presenti dispositivi revisionati con le stesse caratteristiche tecniche richieste dallo specialista.

b) verifica delle condizioni d'uso dell'ausilio ed etichettatura:

1) sostituzione dei componenti obbligatori del dispositivo, ripristinando le condizioni igienico sanitarie dell'ausilio (sanificazione e igienizzazione, adozione di una scheda tecnica da parte dell'azienda erogatrice del servizio, indicante gli interventi eseguiti sul dispositivo, che abbia riscontro con una fascicolazione tecnica di tipo semplificato sottoscritta dal tecnico ortopedico). La consegna ad ogni nuovo utilizzatore delle istruzioni d'uso originarie d'uso, nonché delle informazioni sugli interventi eseguiti.

2) rottamazione del dispositivo nel caso in cui fossero danneggiati parti strutturali; in tal caso il dispositivo sarà inviato alla rottamazione trascorsi 20 giorni dalla avvenuta comunicazione alla ASL.

c) stoccaggio e inventario dell'ausilio ritirato, da mettere a disposizione della ASL medesima.

d) cellosignatura;

e) apposizione della garanzia sui componenti sostituiti nel riutilizzo ha la stessa validità prevista dal DMS 332/99 per gli aggiuntivi a far data dalla riconsegna del dispositivo

f) il fornitore, su specifica autorizzazione della ASL, ha l'obbligo di riconsegnare l'ausilio revisionato ad un altro utente, secondo le modalità della scheda-dispositivo;

g) l'azienda fornitrice deve far sottoscrivere all'interessato, o a chi ne fa le veci, l'apposito modello prestampato riguardante l'avvenuta consegna.

h) la ASL controlla e collauda ogni fornitura di dispositivo che deve essere riutilizzato.

i) I tempi minimi di rinnovo sono quelli previsti dal DMS 332/99 e sono scalabili cumulando il tempo tra la prima e la seconda fornitura

j) Nel caso in cui siano immagazzinati 2 o più dispositivi aventi le stesse caratteristiche tecniche, l'ASL riserva l'assegnazione alla azienda fornitrice che ha ripristinato il dispositivo per prima rispettando il criterio cronologico (data riportata sulla scheda-dispositivo).

k) Le aziende erogatrici aderenti al presente accordo anche in forma associata provvedono all'espletamento del servizio di riutilizzo, nel rispetto delle disposizioni in esso regolamentate.

Art.5

1. Le ASI, devono comunicare all'Assessorato Politiche per la Famiglia, Infanzia e servizi sociali entro il termine di scadenza del presente accordo, i dati relativi ai risultati di gestione conseguiti attraverso l'espletamento del servizio di riutilizzo; ciò al fine di consentire l'esatto monitoraggio della spesa relativa a questo servizio.



TABELLA A
 Dispositivi medici riutilizzabili

ELENCO 2-3	
DESCRIZIONE	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO
DEAMBULATORE (con due ruote e due puntali)	12.06.06.003
DEAMBULATORE rigido (con appoggio al terreno)	12.06.03.003
DEAMBULATORE (con quattro ruote piroettanti)	12.06.09.009
DEAMBULATORE (con quattro ruote piroettanti e freno a pedale su due ruote)	12.06.09.006
BICICLETTA A DUE RUOTE	12.18.03.003
CARROZZINA COMODA (telaio rigido con ruote e wc)	12.21.03.003
CARROZZINA COMODA (telaio rigido con ruote diametro 100 mm - wc e schienale reclinabile)	12.21.03.006
CARROZZINA COMODA (telaio rigido con ruote diametro 200 mm - wc e schienale reclinabile)	12.21.03.006
CARROZZINA COMODA (telaio rigido con ruote grandi posteriori e wc)	12.21.06.003
PASSEGGINO (richiudibile ad ombrello)	12.21.09.003
ALZAMALATI	12.27.03.003
SOLLEVATORE MOBILE ELETTRICO (con imbracatura polifunzionale)	12.30.09.130
SOLLEVATORE MOBILE OLEODINAMICO (con imbracatura polifunzionale)	12.36.03.006
LETTO ARTICOLATO ELETTRICO (con base)	12.36.03.003
BASE OLEODINAMICA PER LETTO	18.12.10.003
LETTO ORTOPEDICO (1 manovella)	18.12.12.106
LETTO ORTOPEDICO (2 manovelle)	18.12.07.003
MONTASCALE MOBILE (a cingoli)	18.12.07.006
	18.30.12.003

H

H

H
8

2

ALLEGATO 3

SCHEDE ICONOGRAFICHE RELATIVE AI DISPOSITIVI

ALLEGATO 2

W

W

DEAMBULATORE

DISPOSITIVO MEDICO RIUTILIZZABILE


INDICAZIONI

- Facilita la deambulazione in interni ed esterni a soggetti con difficile controllo del tronco in posizione eretta, o con limitate possibilità di sostegno degli arti inferiori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Deambulatore chiudibile equipaggiato di:

- Maniglie di appoggio regolabili in altezza
- Ruote anteriori 125mm
- Due puntali antiscivolo
- Telaio pieghevole

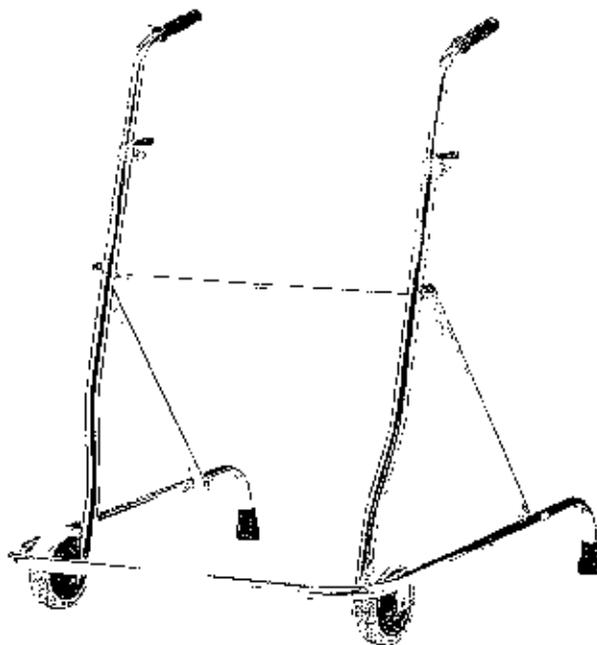

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (C)
12.06.06.003	Deambulatore con due ruote e due puntali di appoggio al terreno	88.00
12.06.09.109	Regolazione della base in altezza	

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.06.09.106	Sedile imbottito e rivestito	18.02

Handwritten signature and date:
12/10

DEAMBULATORE

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

- PUNTALE IN GOMMA (4 PZ)
- MANOPOLA (4 PZ)
- RUOTA (2 PZ)

TOTALE € 16.00
- **SCONTO 20% € 12.80**

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Inclofanatura.

Sostituzione non obbligatoria di componenti, solo se ritenuti usurati a seguito di una valutazione da parte del tecnico:

- SEDILE IMBOTTITO € 26.00

REVISIONE NON OBBLIGATORIA :

- ORGANI DI MOVIMENTO STATICI € 23.00

SECONDA FASE

- Individuazione dell'ausilio, sulla base della prescrizione medica, delle caratteristiche morfologiche e di utilizzo.
- Addestramento all'uso: prova e verifica delle funzionalità dell'ausilio con l'utente dall'addetto tecnico.
- Consegna domiciliare 3 giorni lavorativi dall'autorizzazione .
- Verifica pos-vendita del mantenimento dei requisiti di funzionalità:

RIEPILOGO DEI COSTI	
DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	12.80
IGIENIZZAZIONE	15.00
RITIRO = RICONSEGNA	15.00
*MANODOPERA	5.00
TOTALE	47.80

* N.B. IL COSTO DELLA MANODOPERA COMPRENDE SIA IL RIPRISTINO OBBLIGATORIO CHE EVENTUALI SOSTITUZIONI NON OBBLIGATORIE.

VALORE ECONOMICO DEL DISPOSITIVO NUOVO:

€ 88.00


Handwritten signature and date: 11/8

DEAMBULATORE

DISPOSITIVO MEDICO RIUTILIZZABILE

INDICAZIONI


- Facilita la deambulazione in interni ed esterni a soggetti con difficile controllo del tronco in posizione eretta o con limitate possibilità di sostegno degli arti inferiori

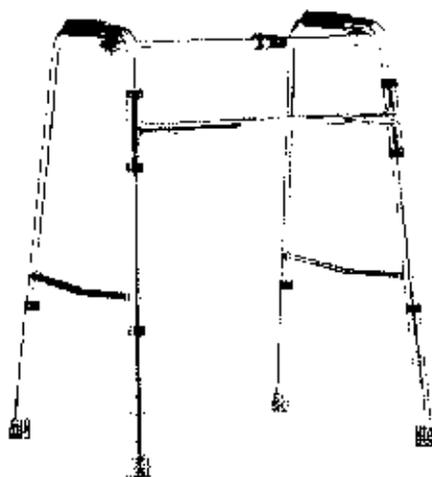

CARATTERISTICHE TECNICHE

Deambulatore rigido con appoggio al terreno

- Telaio in alluminio regolabile da cm 78,5 a cm 91,5
- Manopole morbide in poliuretano
- Tappi antiscivolo alle basi
- Telaio pieghevole

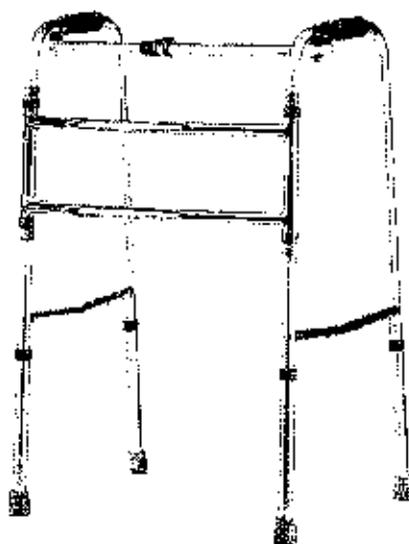

Deambulatore articolato con appoggio al terreno adatto a seguire il passo del paziente

- Telaio in alluminio regolabile da cm 78,5 a cm 91,5
- Manopole morbide in poliuretano
- Tappi antiscivolo alle basi
- Telaio pieghevole

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
12.06.03.003	Deambulatore rigido con appoggio al terreno	72.00
12.06.09.130	Telaio pieghevole	
12.06.09.109	Regolazione della base in altezza	
12.06.03.006	Deambulatore articolato con appoggio al terreno	81.00
12.06.09.130	Telaio pieghevole	
12.06.09.109	Regolazione della base in altezza	

M. S.
12.04

DEAMBULATORE

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

➤ PUNTALE IN GOMMA (4 PZ)

TOTALE € 8.00
- **SCONTO 20% € 6.40**

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Inclofanatura.

SECONDA FASE

- Individuazione dell'ausilio, sulla base della prescrizione medica, delle caratteristiche morfologiche e di utilizzo.
- Addestramento all'uso: prova e verifica delle funzionalità dell'ausilio con l'utente dall'addetto tecnico.
- Consegna domiciliare 3 giorni lavorativi dall'autorizzazione .
- Verifica pos-vendita del mantenimento dei requisiti di funzionalità:


REVISIONE NON OBBLIGATORIA,
a seguito di una valutazione da parte del tecnico:

- **ORGANI DI MOVIMENTO STATICI**
€ 23.00

RIEPILOGO DEI COSTI	
DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	6.40
IGIENIZZAZIONE	15.00
RITIRO E RICONSEGNA	15.00
MANODOPERA	5.00
TOTALE	41.40

* **N.B.** IL COSTO DELLA MANODOPERA COMPRENDE SIA IL RIPRISTINO OBBLIGATORIO CHE EVENTUALI SOSTITUZIONI NON OBBLIGATORIE

**VALORE ECONOMICO DEL
DISPOSITIVO NUOVO:**
€ 81.00 ARTICOLATO
€ 72.00 FISSO

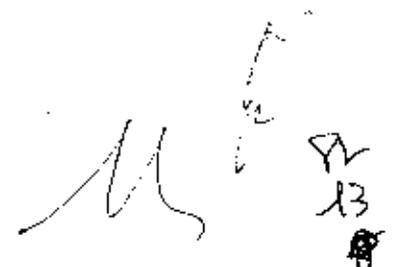
13

DEAMBULATORE

DISPOSITIVO MEDICO RIUTILIZZABILE


INDICAZIONI

- Facilita la deambulazione in interni ed esterni a soggetti con difficile controllo del tronco in posizione eretta o con limitate possibilità di sostegno degli arti inferiori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Deambulatore chiudibile equipaggiato di:

- Manubrio regolabile in altezza
- Ascellari imbottiti e regolabili in altezza
- Base regolabile in altezza
- Chiusura a crociera
- Ruote anteriori piroettanti mm80
- Ruote posteriori piroettanti mm80
- Freno di stazionamento a pedale

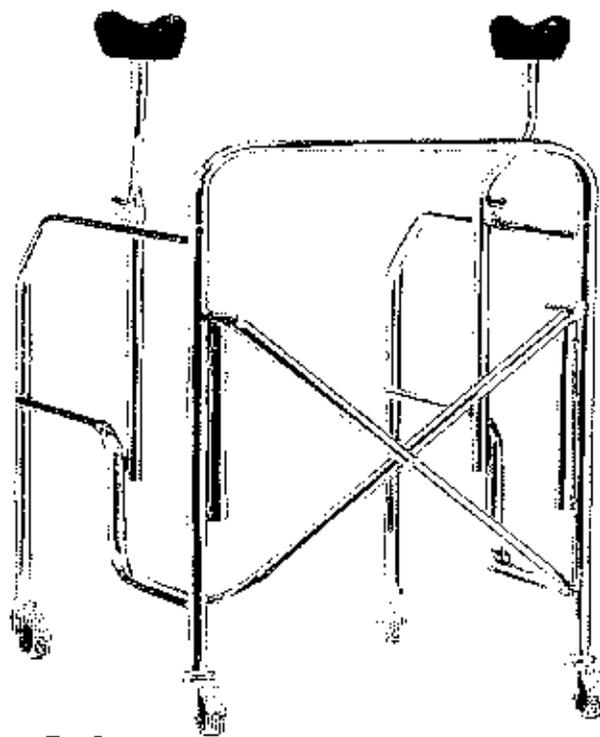

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
12.06.09.009	Deambulatore con quattro ruote piroettanti	155.00
12.06.09.130	Telaio pieghevole	
12.06.09.142	Manubrio anteriore regolabile	
12.06.09.006	Deambulatore con quattro ruote piroettanti e freno a pedale su due ruote	161.00
12.06.09.130	Telaio pieghevole	
12.06.09.142	Manubrio anteriore regolabile	

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.06.09.106	Sedile imbottito e rivestito	26.00
12.06.09.124	Appoggio antibrachiale	62.00

Handwritten signature and date: 2/11/08

DEAMBULATORE

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

- RUOTE(2 pz)
- RUOTE(2 pz)
- APPOGGI SOTTOASCELLARI (2 PZ)

TOTALE € 40.00
- **SCONTO 20% € 32.00**

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Incelofanatura.

Sostituzione non obbligatoria di componenti, solo se ritenuti usurati a seguito di una valutazione da parte del tecnico:

- MANOPOLE DI BLOCCAGGIO(1 PZ) € 2,07
- SEDILE IMBOTITO € 26,00
- APPOGGIO ANTIBRACIALE € 62,00

REVISIONE NON OBBLIGATORIA :

- ORGANI DI MOVIMENTO STATICI € 23,00

SECONDA FASE

- Individuazione dell'ausilio, sulla base della prescrizione medica, delle caratteristiche morfologiche e di utilizzo.
- Addestramento all'uso: prova e verifica delle funzionalità dell'ausilio con l'utente dall'addetto tecnico.
- Consegna domiciliare 3 giorni lavorativi dall'autorizzazione.
- Verifica pos-vendita del mantenimento dei requisiti di funzionalità.

VALORE ECONOMICO DEL DISPOSITIVO NUOVO:

€ 155.00

€ 161.00 (con ruote frenanti)

RIEPILOGO DEI COSTI	
DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	32.00
IGIENIZZAZIONE	25.00
RITIRO E RICONSEGNA	15.00
MANODOPERA	10.00
TOTALE	82.00

* N.B. IL COSTO DELLA MANODOPERA COMPRENDE
SIA IL RIPRISTINO OBBLIGATORIO CHE EVENTUALI
SOSTITUZIONI NON OBBLIGATORIE


Handwritten signature and date: 15

DEAMBULATORE

DISPOSITIVO MEDICO RIUTILIZZABILE

INDICAZIONI

- Facilita la deambulazione in interni ed esterni a soggetti con difficile controllo del tronco in posizione eretta o con limitate possibilità di sostegno degli arti inferiori

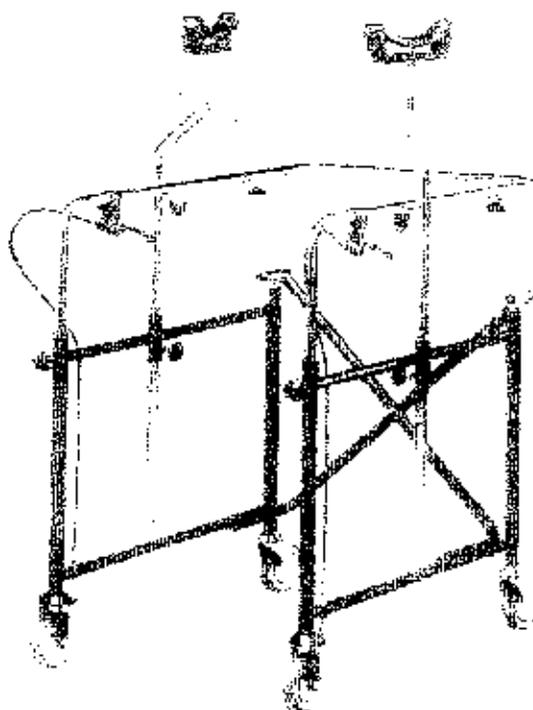

CARATTERISTICHE TECNICHE

Deambulatore chiudibile equipaggiato di:

- Ascellari imbottiti e regolabili in altezza
- Base regolabile in altezza
- Chiusura a crociera
- Ruote anteriori piroettanti mm100
- Ruote posteriori piroettanti mm100 con freno azionabile a mano
- Freno a mano

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
12.06.09.009	Deambulatore con quattro ruote con freno azionabile a mano	260.09
12.06.09.109	Regolazione della base in altezza	
12.06.09.130	Telaio pieghevole	
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.06.09.106	Sedile imbottito e rivestito	18.02
12.06.09.124	Appoggio antibrachiale	30.00

[Handwritten signature]
16

DEAMBULATORE

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

- RUOTE(4 PZ)
- APPOGGI SOTTOASCELLARI (2 PZ)

TOTALE € 62.88
- SCONTO 20% € 50.30

Sostituzione non obbligatoria di componenti,
solo se ritenuti usurati a seguito di una valutazione
da parte del tecnico:

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Incelofanatura.

- MANOPOLE DI BLOCCAGGIO(1 PZ) € 2.07
- SEDILE IMBOTTITO € 18.02
- APPOGGIO ANTIBRACHIALE € 60.00
- FRENO(2 PZ) € 44.36

REVISIONE NON OBBLIGATORIA :

- ORGANI DI MOVIMENTO STATICI € 23.00

SECONDA FASE

- Individuazione dell'ausilio, sulla base della prescrizione medica, delle caratteristiche morfologiche e di utilizzo.
- Addestramento all'uso: prova e verifica delle funzionalità dell'ausilio con l'utente dall'addetto tecnico.
- Consegna domiciliare 3 giorni lavorativi dall'autorizzazione.
- Verifica pos-vendita del mantenimento dei requisiti di funzionalità.

RIEPILOGO DEI COSTI	
DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	50.30
IGIENIZZAZIONE	25.00
RITIRO E RICONSEGNA	15.00
MANODOPERA	10.00
TOTALE	100.30

**VALORE ECONOMICO DEL
DISPOSITIVO NUOVO:**
€ 260.09

* N.B. il COSTO DELLA MANODOPERA COMPRENDE
SIA IL RIPRISTINO OBBLIGATORIO CHE EVENTUALI
SOSTITUZIONI NON OBBLIGATORIE

BICIA DUE RUOTE


DISPOSITIVO MEDICO RIUTILIZZABILE

INDICAZIONI

- Serve ad aumentare l'autonomia fisica ma soprattutto psicologica e di relazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Telaio in acciaio cromato e/o verniciato e/o in lega con una forcella ed un manubrio anteriormente con due ruote grandi ed una forcella posteriormente.
- La ruota posteriore è munita di un rocchetto dentato per la trasmissione del moto
- E' munita di freni, pedivella, catena catarifrangenti, fanale anteriore e dinamo.
- Posteriormente una coppia di stabilizzatori regolabili, con due ruote di almeno mm 200 assicura la stabilità laterale

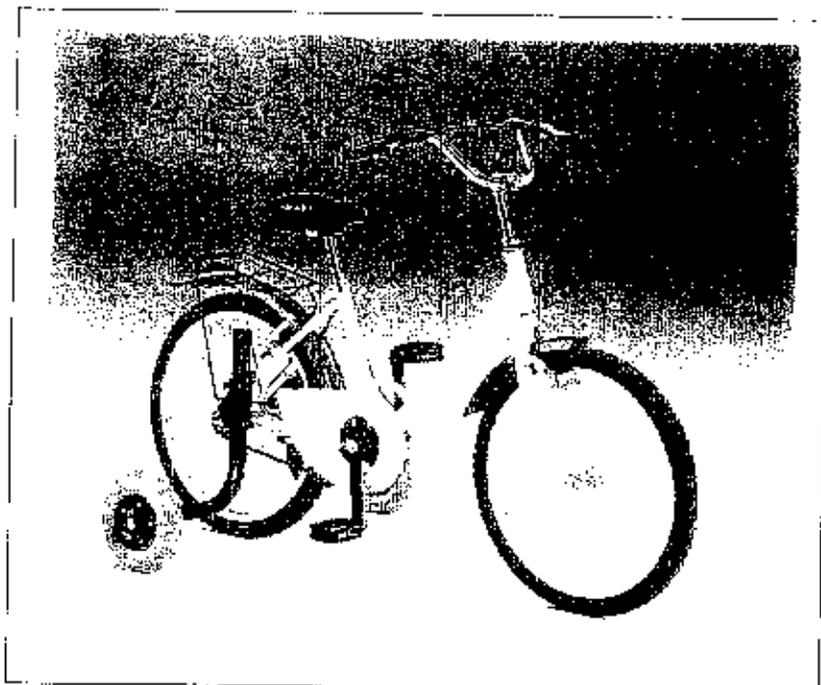

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
12.18.03.003	BICICLETTA A DUE RUOTE	290,00
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.18.21.127	Sella lunga per abduzione	16,53
12.18.21.130	Ammortizzatori agli stabilizzatori	

Handwritten signature and date:
18/10

BICIA DUE RUOTE

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

- ✓ RUOTA COMPLETA 200X50
- ✓ COPERTONI COMPLETI DI CAMERE D'ARIA
- ✓ SELLA
- ✓ FRENI

TOTALE € 145.00
- **SCONTO 20%** € **116.00**

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Incelofanatura.

REVISIONE NON OBBLIGATORIA :

- **ORGANI DI MOVIMENTO STATICI**
€ 23.00

RIEPILOGO DEI COSTI	
DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	116.00
IGIENIZZAZIONE	25.00
RITIRO E RICONSEGNA	15.00
* MANODOPERA	20.00
TOTALE	176.00

* N.B. IL COSTO DELLA MANODOPERA COMPRENDE SIA IL RIPRISTINO OBBLIGATORIO CHE EVENTUALI SOSTITUZIONI NON OBBLIGATORIE

VALORE ECONOMICO DEL DISPOSITIVO NUOVO:

€ 290.00


2/12
19
AA

CARROZZINA COMODA

INDICAZIONI

- Serve a facilitare l'assistenza negli spostamenti in interni/esterni di soggetti non deambulanti che necessitano dell'aiuto dell'accompagnatore



CARATTERISTICHE TECNICHE

Carrozzina a telaio rigido (con possibilità di telaio chiudibile) manovrabile dall'accompagnatore equipaggiata di:

- Dispositivo wc con vaschetta estraibile
- Spalliera e sedile imbottiti e rivestiti con materiale lavabile
- Braccioli estraibili, imbottiti e rivestiti con materiale lavabile
- Pedane ribaltabili, girevoli e regolabili in altezza
- Ruote anteriori piroettanti mm100
- Ruote posteriori piroettanti mm100 con freno azionabile a pedale
- Grazie alla sua concezione può accedere direttamente sul water

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
12.21.03.003	Carrozzina a telaio rigido con ruote e dispositivo wc	176.00

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.24.06.103	Cinghia pettorale	24.00
12.24.06.106	Divaricatore imbottito e regolabile	68.00
12.24.06.118	Braccioni regolabili in altezza (paio)	78.00
12.24.15.106	Tavolino con incavo avvolgente ai bordi	62.00
12.24.06.127	Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili	29,00 x 1
12.24.06.124	Variazione lunghezza sedile superiore a 50 cm	110.00
12.24.06.121	Variazione larghezza inferiore a cm 40	110.00

Handwritten signature and date:
28/02/17

CARROZZINA COMODA

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

- > SCHIENALE
- > SEDILE
- > BRACCIOLO (2 PZ)
- > BACINELLA

TOTALE € 81.00
- **SCONTO 20% € 64.80**

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Incelofanatura.

SECONDA FASE

- Individuazione dell'ausilio, sulla base della prescrizione medica, delle caratteristiche morfologiche e di utilizzo.
- Addestramento all'uso: prova e verifica delle funzionalità dell'ausilio con l'utente dall'addetto tecnico.
- Consegna domiciliare 3 giorni lavorativi dall'autorizzazione.
- Verifica pos-vendita del mantenimento dei requisiti di funzionalità.

Sostituzione non obbligatoria di componenti, solo se ritenuti usurati a seguito di una valutazione da parte del tecnico:

- RUOTE (4 PZ) € 36.00
- PEDANE (2 PZ) € 8.00
- FRENI (2 PZ) € 16.00

REVISIONE NON OBBLIGATORIA :

- ORGANI DI MOVIMENTO STATICI € 23.00

RIEPILOGO DEI COSTI	
DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	64.80
IGIENIZZAZIONE	25.00
RITIRO E RICONSEGNA	15.00
* MANODOPERA	20.00
TOTALE	124.80

VALORE ECONOMICO DEL DISPOSITIVO NUOVO:

€ 176.00

* N.B. IL COSTO DELLA MANODOPERA COMPRENDE S.A. IL RIPRISTINO OBBLIGATORIO CHE EVENTUALI SOSTITUZIONI NON OBBLIGATORIE

[Handwritten signature and date]
21/12


CARROZZINA
COMODA

INDICAZIONI

- Serve a facilitare l'assistenza negli spostamenti in interni/esterni di soggetti non deambulanti che necessitano dell'aiuto dell'accompagnatore

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carrozzina a telaio rigido reclinabile
- Dispositivo wc con vaschetta estraibile
- Spalliera regolabile in inclinazione da 90° a 140°
- Imbottiture anatomiche rivestite in materiale lavabile
- Braccioli estraibili, imbottiti e rivestiti con materiale lavabile
- Pedane ribaltabili, regolabili in altezza e inclinazione con poggia polpaccio
- Ruote anteriori piroettanti 200 mm x 50
- Ruote posteriori piroettanti mm100 con freno azionabile a trapezio
- Grazie alla sua concezione può accedere direttamente sul water

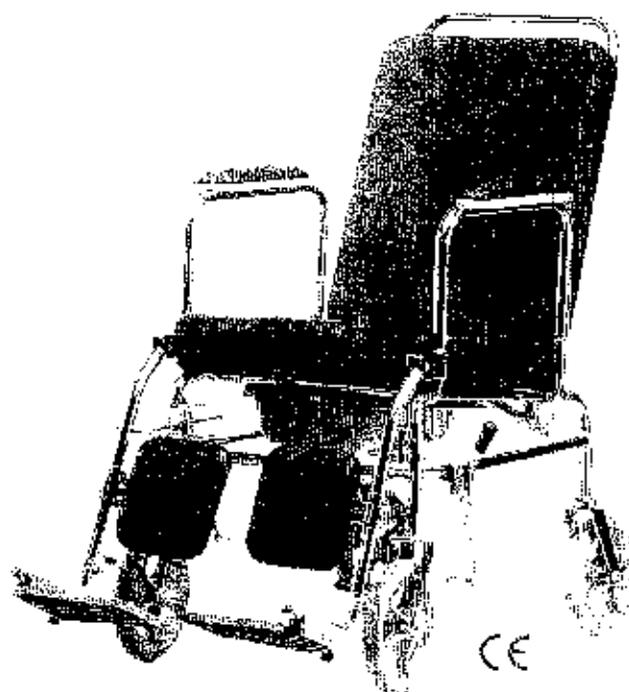

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
12.21.03.006	Carrozzina a telaio rigido con schienale reclinabile e dispositivo wc	377,00
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.24.06.103	Cinghia pettorale	24,00
12.24.06.106	Divaricatore imbottito e regolabile	68,00
12.24.06.118	Braccioli regolabili in altezza (paio)	78,00
12.24.15.106	Tavolino con incavo avvolgente ai bordi	62,00
12.24.06.127	Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili	29,00 x 1
12.24.06.124	Variazione larghezza sedile superiore a 50 cm	110,00
12.24.06.121	Variazione larghezza inferiore a cm 40	110,00
12.24.06.112	Schienale prolungato regolabile o poggiatesta	37,00
12.24.06.115	Protezione laterale parietale bilaterale	73,00

Handwritten signature and date:
12/22

CARROZZINA COMODA

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

- SCHIENALE
- SEDILE
- BRACCIOLO (2 PZ)
- PARAPOLPACCI (2 PZ)
- BACINELLA

TOTALE € 146.15
- **SCONTO 20% € 116.92**

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Incelofanatura.

SECONDA FASE

- Individuazione dell'ausilio, sulla base della prescrizione medica, delle caratteristiche morfologiche e di utilizzo.
- Addestramento all'uso; prova e verifica delle funzionalità dell'ausilio con l'utente dall'addetto tecnico.
- Consegna domiciliare 3 giorni lavorativi dall'autorizzazione.
- Verifica pos-vendita del mantenimento dei requisiti di funzionalità.

Sostituzione non obbligatoria di componenti, solo se ritenuti usurati a seguito di una valutazione da parte del tecnico:

- RUOTE (4 PZ) € 64.00
- PEDANE (2 PZ) € 8.00
- FRENI (2 PZ) € 16.00

REVISIONE NON OBBLIGATORIA :

- ORGANI DI MOVIMENTO STATICI € 23.00

RIEPILOGO DEI COSTI	
DESCRIZIONE	PREZZO (€)
K.T. DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	116.92
IGIENIZZAZIONE	25.00
RITIRO E RICONSEGNA	15.00
MANODOPERA	20.00
TOTALE	176.92

VALORE ECONOMICO DEL DISPOSITIVO NUOVO:

€ 377.00

* N.B. IL COSTO DELLA MANODOPERA COMPRENDE SIA IL RIPRISTINO OBBLIGATORIO CHE EVENTUALI SOSTITUZIONI NON OBBLIGATORIE

Handwritten signature and date:
15/23


**CARROZZINA
COMODA**

INDICAZIONI

- Serve a facilitare l'assistenza negli spostamenti in interni/esterni di soggetti non deambulanti che necessitano dell'aiuto dell'accompagnatore

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

- Carrozzina a telaio rigido reclinabile
- Dispositivo wc con vaschetta estraibile
- Spalliera regolabile in inclinazione da 90° a 140°
- Imbottiture anatomiche rivestite in materiale lavabile
- Braccioli estraibili, imbottiti e rivestiti con materiale lavabile
- Pedane ribaltabili, regolabili in altezza e inclinazione con poggia polpaccio
- Ruote anteriori piroettanti mm100
- Ruote posteriori piroettanti mm100 con freno azionabile a pedale
- Grazie alla sua concezione può accedere direttamente sul water

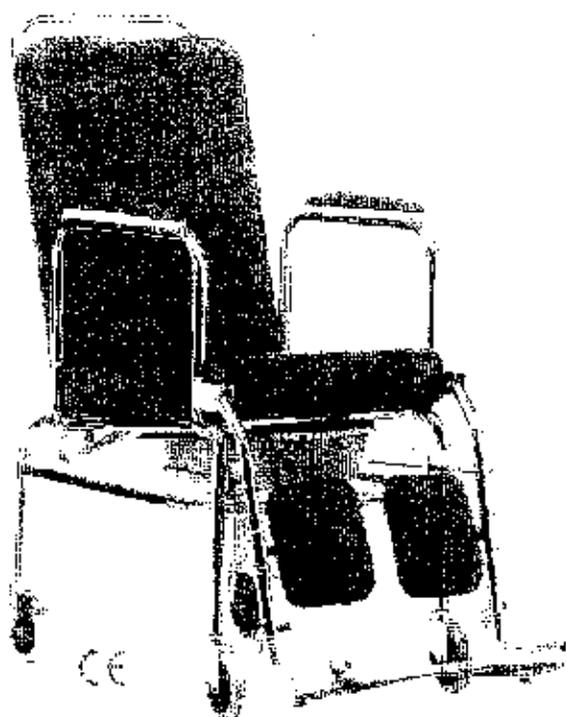

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
12.21.03.006	Carrozzina a telaio rigido con schienale reclinabile e dispositivo wc	290,00
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.24.06.103	Cinghia pettorale	24,00
12.24.06.106	Divaricatore imbottito e regolabile	68,00
12.24.06.118	Braccioli regolabili in altezza (paso)	78,00
12.24.15.106	Favolino con incevo avvolgente ai bordi	62,00
12.24.06.127	Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili	29,00 x 1
12.24.06.124	Variazione larghezza sedile superiore a 50 cm	110,00
12.24.06.121	Variazione larghezza inferiore a cm 40	110,00
12.24.06.112	Schienale prolungato regolabile o poggiatesta	37,00
12.24.06.115	Protezione laterale parietale bilaterale	73,00

Handwritten signature and date:
 24/02/24
 AS

CARROZZINA COMODA

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

- > SCHIENALE
- > SEDILE
- > BRACCIOLO (2 PZ)
- > PARAPOLPACCI (2 PZ)
- > BACINELLA

TOTALE € 146,15
- **SCONTO 20% € 116,92**

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Inciclofanatura.

Sostituzione non obbligatoria di componenti, solo se ritenuti usurati a seguito di una valutazione da parte del tecnico:

- RUOTE (4 PZ) € 36.00
- PEDANE (2 PZ) € 8.00
- FRENI (2 PZ) € 16.00

REVISIONE NON OBBLIGATORIA :

- ORGANI DI MOVIMENTO STATICI € 23.00

SECONDA FASE

- Individuazione dell'ausilio, sulla base della prescrizione medica, delle caratteristiche morfologiche e di utilizzo.
- Addestramento all'uso: prova e verifica delle funzionalità dell'ausilio con l'utente dall'addetto tecnico.
- Consegna domiciliare 3 giorni lavorativi dall'autorizzazione.
- Verifica pos-vendita del mantenimento dei requisiti di funzionalità.

RIEPILOGO DEI COSTI

DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	116,92
IGIENIZZAZIONE	25,00
RITIRO E RICONSEGNA	15,00
* MANODOPERA	20,00
TOTALE	176,92

VALORE ECONOMICO DEL DISPOSITIVO NUOVO:

€ 290,00

* N.B. IL COSTO DELLA MANODOPERA COMPRENDE
SIA IL RIPRISTINO OBBLIGATORIO CHE EVENTUALI
SOSTITUZIONI NON OBBLIGATORIE

M. 25


CARROZZINA
COMODA

INDICAZIONI

- Serve ad aumentare l'autonomia negli spostamenti in interni a soggetti in grado di utilizzare arti superiori
- Consente l'espletamento di funzioni intestinali e urinarie in posizione seduta quando non sia utilizzabile il normale wc
- Non idonea a prolungato utilizzo nella giornata

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carrozzina a telaio rigido per interni ed esterni
- Dispositivo wc con vaschetta estraibile
- Spalliera regolabile in inclinazione da 90° a 140°
- Imbottiture anatomiche rivestite in materiale lavabile
- Braccioli estraibili, imbottiti e rivestiti con materiale lavabile
- Pedane ribaltabili, regolabili in altezza e inclinazione con poggia polpaccio
- Ruote grandi anteriori/posteriori piroettanti 600 mm con cerchi autospinta e freni di stazionamento
- Ruote anteriori/posteriori piroettanti mm 200 x 50
- Grazie alla sua concezione può accedere direttamente sul water

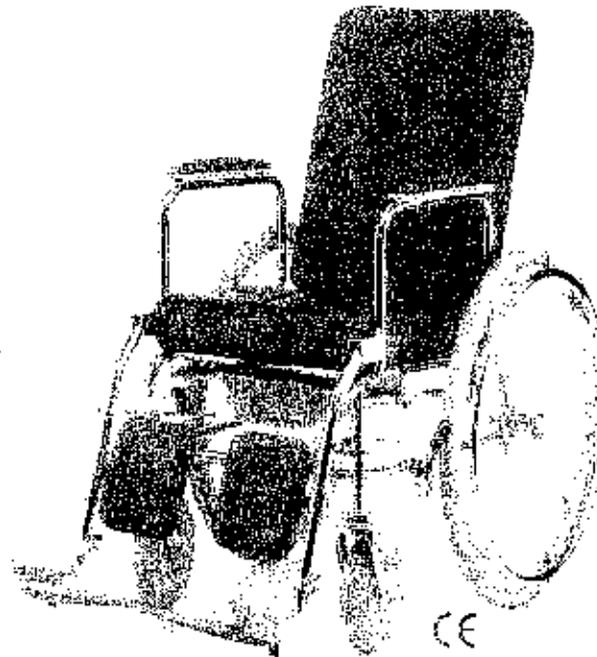

• 12.21.06.003: CARROZZINA A TELAI RIGIDO AD AUTOSPINTA SULLE RUOTE POSTERIORI

• 12.21.09.003: CARROZZINA A TELAI RIGIDO AD AUTOSPINTA SULLE RUOTE ANTERIORI

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
12.21.06.003 12.21.09.003 *	Carrozzina a telaio rigido con ruote grandi posteriori e dispositivo wc	444.00
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.24.06.103	Cinghia pettorale	24.00
12.24.06.106	Divaricatore imbottito e regolabile	68.00
12.24.06.118	Braccioli regolabili in altezza (paio)	78.00
12.24.15.106	Tavolino con incavo avvolgente ai bordi	62.00
12.24.06.127	Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili	29.00 x 1
12.24.06.124	Variazione larghezza sedile superiore a 50 cm	110.00
12.24.06.121	Variazione larghezza inferiore a cm 40	110.00
12.24.06.112	Schiena prolungata regolabile o poggiatesta	37.00
12.24.06.115	Protezione laterale parietale bilaterale	73.00

Handwritten signature and number 26.

CARROZZINA COMODA

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

- SCHIENALE
- SEDILE
- BRACCIOLO (2 PZ)
- PARAPOLPACCI (2 PZ)
- BACINELLA

TOTALE € 146.15
- **SCONTO 20% € 116.92**

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Incelofanatura.

Sostituzione non obbligatoria di componenti, solo se ritenuti usurati a seguito di una valutazione da parte del tecnico:

- RUOTE (4 PZ) € 146.00
- PEDANE (2 PZ) € 8.00
- FRENI (2 PZ) € 16.00

REVISIONE NON OBBLIGATORIA :

- ORGANI DI MOVIMENTO STATICI € 23.00

SECONDA FASE

- Individuazione dell'ausilio, sulla base della prescrizione medica, delle caratteristiche morfologiche e di utilizzo.
- Addestramento all'uso: prova e verifica delle funzionalità dell'ausilio con l'utente dall'addetto tecnico.
- Consegna domiciliare 3 giorni lavorativi dall'autorizzazione.
- Verifica pos-vendita del mantenimento dei requisiti di funzionalità.

RIEPILOGO DEI COSTI	
DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	116.92
IGIENIZZAZIONE	25.00
RITIRO E RICONSEGNA	15.00
* MANODOPERA	20.00
TOTALE	176.92

VALORE ECONOMICO DEL DISPOSITIVO NUOVO:

€ 444.00

* N.B. IL COSTO DELLA MANODOPERA COMPRENDE SIA IL RIPRISTINO OBBLIGATORIO CHE EVENTUALI SOSTITUZIONI NON OBBLIGATORIE.

[Handwritten signature and date]
27/10

PASSEGGINO AD OMBRELLO

❖ DISPOSITIVO MEDICO NON RIUTILIZZABILE

INDICAZIONI

- Concepito per il trasporto del bambino disabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Telaio in lega di alluminio
- Telaio ad ombrello stabilizzante
- 2 ruote anteriori piroctanti 175mm
- 2 ruote posteriori 175mm con freno
- Tela sedile in tessuto lavabile
- Pedana poggiapiedi intera regolabile e rimovibile
- Dispositivo di sicurezza per chiusura passeggino
- Cinghia pettorale



CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
12.27.03.003	PASSEGGINO CHIUDIBILE AD OMBRELLO	620,00
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.27.03.103	RIDUTTORE DI LARGHEZZA DEL SEDILE	99,00
12.27.03.106	DIVARICATORE IMBOTTITO	68,00

❖ NON E' POSSIBILE IL RIUTILIZZO IN QUANTO TRATTASI DI AUSILIO DI IMPORTAZIONE. NON ESISTONO PEZZI DI RICAMBIO

M
28
28

ALZAMALATI

DISPOSITIVO MEDICO RIUTILIZZABILE

INDICAZIONI

- Facilita il sollevamento del malato



CARATTERISTICHE TECNICHE

ALZAMALATI A BASE

- Struttura in tubo di acciaio cromato
- Solida base in acciaio verniciato con tappi in polietilene
- Struttura regolabile in altezza
- Triangolo con cinghia regolabile
- Altezza cm 200-250

ALZAMALATI AD INNESTO

- Struttura in tubo di acciaio cromato
- Fissaggio a morsetto
- Triangolo con cinghia regolabile
- Altezza max 190 cm

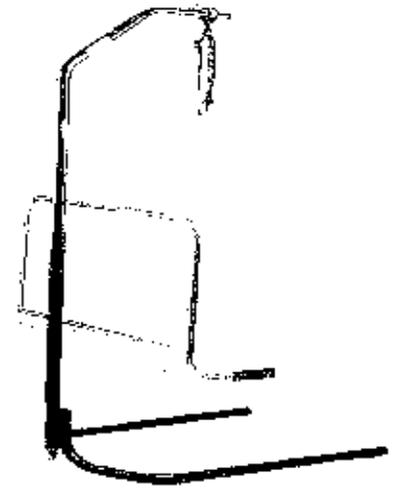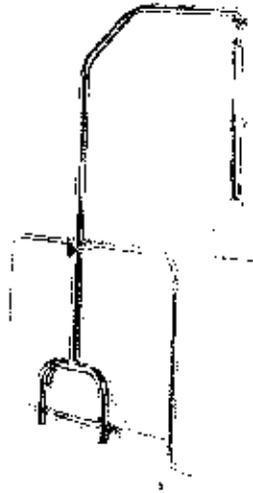

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
12.30.09.130	SUPPORTO ALZAMALATI AD INNESTO	88.00
12.30.09.130	SUPPORTO ALZAMALATI A BASE	104.00

[Handwritten signature]
22
29
2+

ALZAMALATI

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

➤ CINGHIA E TRIANGOLO

TOTALE € 17.00
- SCONTO 20% € 13.60

Sostituzione non obbligatoria di componenti,
solo se ritenuti usurati a seguito di una valutazione
da parte del tecnico:

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Incelofanatura.

- MORSETTO (ALZAMALATI AD INNESTO) € 20.00

REVISIONE NON OBBLIGATORIA :

- ORGANI DI MOVIMENTO STATICI € 23.00

SECONDA FASE

- Individuazione dell'ausilio, sulla base della prescrizione medica, delle caratteristiche morfologiche e di utilizzo.
- Addestramento all'uso: prova e verifica delle funzionalità dell'ausilio con l'utente dall'addetto tecnico.
- Consegna domiciliare 3 giorni lavorativi dall'autorizzazione.
- Verifica pos-vendita del mantenimento dei requisiti di funzionalità.

RIEPILOGO DEI COSTI	
DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	13.60
IGIENIZZAZIONE	15.00
RITIRO E RICONSEGNA	15.00
*MANODOPERA	5.00
TOTALE	48.60

VALORE ECONOMICO DEL DISPOSITIVO NUOVO:

€ 88.00 (AD INNESTO)

€ 104.00 (A BASE)

* N.B. IL COSTO DELLA MANODOPERA COMPRENDE
SIA IL RIPRISTINO OBBLIGATORIO CHE EVENTUALI
SOSTITUZIONI NON OBBLIGATORIE

[Handwritten signature]
82
30
22


SOLLEVATORE ELETTRICO

INDICAZIONI

- Facilita l'assistenza ed i trattamenti (letto-carrozzina-bagno) in soggetti non autonomi. Necessita di spazi utili (dimensioni ambienti, conformazione letto)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sollevatore mobile a imbracatura polifunzionale, indicato per lo spostamento di invalidi che non residuano di alcuna capacità di spostamento autonomo
- Base regolabile in larghezza
- Ruote piroettanti mm 100 le posteriori con freno
- Comando a filo
- Motore elettrico di sollevamento con batterie ricaricabili
- Caricabatteria
- Mensola porta-batterie
- Segnalatore sonoro di scarico delle batterie
- Braccio di sollevamento con tre posizioni di portata
- Imbracatura in tela di cotone plastificato, a fasce avvolgenti
- Struttura in tubo di acciaio saldato e verniciato
- Portata massima kg 120

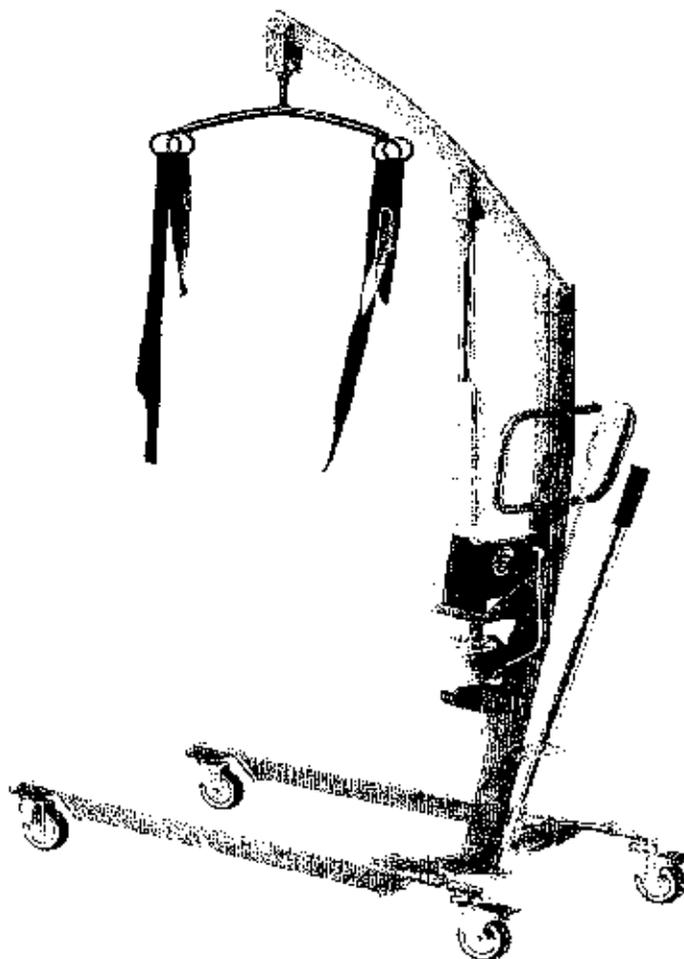

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
12.36.03.006	Sollevatore mobile elettrico con imbracatura polifunzionale	1085,00
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.36.03.103	Imbracatura con poggiatesta	78,00
12.36.03.003	Imbracatura ad amaca intera	119,00
12.36.03.003	Imbracatura ad amaca forata	176,00


 31
 23

SOLLEVATORE ELETTRICO

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

- IMBRACATURA STANDARD
- BATTERIE AL PAIO

TOTALE € 172.00
- SCONTO 20% € 137.60

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Inclofanatura.

SECONDA FASE

- Individuazione dell'ausilio, sulla base della prescrizione medica, delle caratteristiche morfologiche e di utilizzo.
- Addestramento all'uso; prova e verifica delle funzionalità dell'ausilio con l'utente dall'addetto tecnico.
- Consegna domiciliare 3 giorni lavorativi dall'autorizzazione.
- Verifica pos-vendita del mantenimento dei requisiti di funzionalità.

Sostituzione non obbligatoria di componenti, solo se ritenuti usurati a seguito di una valutazione da parte del tecnico:

- IMBRACATURA CON POGGIAIATESTA € 78.00
- IMBRACATURA AD AMACA INTERA € 119.000
- IMBRACATURA AD AMACA FORATA € 176.00
- MOTORE COMPLETO DE CENTRALINA E BATTERIE € 506.00
- CARICABATTERIE € 104.00

REVISIONE NON OBBLIGATORIA :

- ORGANI DI MOVIMENTO STATICI € 23.00

RIEPILOGO DEI COSTI

DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	137.60
IGIENIZZAZIONE	25.00
RITIRO E RICONSEGNA	15.00
*MANODOPERA	20.00
TOTALE	197.60

**VALORE ECONOMICO DEL
DISPOSITIVO NUOVO:**

€ 1085.00

* N.B. IL COSTO DELLA MANODOPERA COMPRENDE
SIA IL RIPRISTINO OBBLIGATORIO CHE EVENTUALI
SOSTITUZIONI NON OBBLIGATORIE.

[Handwritten signature and date]
32


SOLLEVATORE
OLEODINAMICO

INDICAZIONI

- Facilita l'assistenza ed i trattamenti (letto-carrozzina-bagno) in soggetti non autonomi. Necessita di spazi utili (dimensioni ambienti, conformazione letto)

CARATTERISTICHE
TECNICHE

- Sollevatore mobile a imbracatura polifunzionale, indicato per lo spostamento di invalidi che non residuano di alcuna capacità di spostamento autonomo
- Base regolabile in larghezza
- Ruote piroettanti mm 100 le posteriori con freno
- Pompa oleodinamica con leva laterale per movimenti di salita
- Sistema di discesa con volantino a regolazione manuale
- Braccio di sollevamento con tre posizioni di portata
- Imbracatura in tela di cotone plastificato, a fasce avvolgenti
- Struttura in tubo di acciaio saldato e verniciato
- Portata massima kg 120

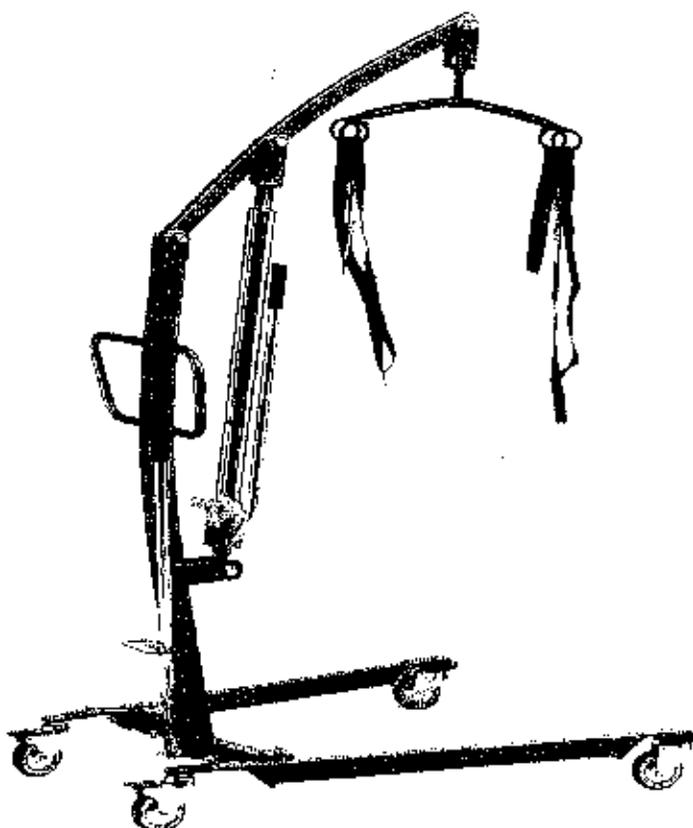

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
12.36.03.003	Sollevatore mobile oleodinamico con imbracatura polifunzionale	723.00
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.36.03.103	Imbracatura con poggiatesta	78.00
12.36.03.003	Imbracatura ad amaca intera	119.00
12.36.03.003	Imbracatura ad amaca forata	176.00

Handwritten signature and date:
25/33

SOLLEVATORE

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

- IMBRACATURA STANDARD
- POMPA

TOTALE € 342.00
-SCONTO 20% € 273.60

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Incelofanatura.

Sostituzione non obbligatoria di componenti, solo se ritenuti usurati a seguito di una valutazione da parte del tecnico:

- IMBRACATURA CON POGGIAIATESTA € 78.00
- IMBRACATURA AD AMACA INTERA € 119.000
- IMBRACATURA AD AMACA FORATA € 176.00

REVISIONE NON OBBLIGATORIA :

- ORGANI DI MOVIMENTO STATICI € 23.00

SECONDA FASE

- Individuazione dell'ausilio, sulla base della prescrizione medica, delle caratteristiche morfologiche e di utilizzo.
- Addestramento all'uso: prova e verifica delle funzionalità dell'ausilio con l'utente dall'addetto tecnico.
- Consegna domiciliare 3 giorni favorativi dall'autorizzazione.
- Verifica pos-vendita del mantenimento dei requisiti di funzionalità.

RIEPILOGO DEI COSTI

DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	273.60
IGIENIZZAZIONE	25.00
RITIRO E RICONSEGNA	15.00
*MANODOPERA	20.00
TOTALE	333.60

VALORE ECONOMICO DEL DISPOSITIVO NUOVO:

€ 723.00

* N.B. IL COSTO DELLA MANODOPERA COMPRENDI SIA IL RIPRISTINO OBBLIGATORIO CHE EVENTUALI SOSTITUZIONI NON OBBLIGATORIE

Handwritten signature and date:
26/39


LETTO ELETTRICO

INDICAZIONI

- Facilita l'assistenza in quanto permette di variare l'assetto del letto e quindi l'allineamento del paziente allettato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rete collegata a telaio articolato a 3 snodi a motore
- Base elettrica regolabile in altezza con quattro ruote paracolpi mm 30 x 1,5
- Movimentazione verticale elettrica del piano rete
- Alzatesta e alzagamba regolabili tramite comando
- Testata e pediera smontabili cromate
- Gambe smontabili in tubo d'acciaio verniciato mm 50
- Pannelli in laminato plastico
- Inclinazione della testata max 60°, portata 60 kg
- Inclinazione della pediera max 40°, portata 50 kg

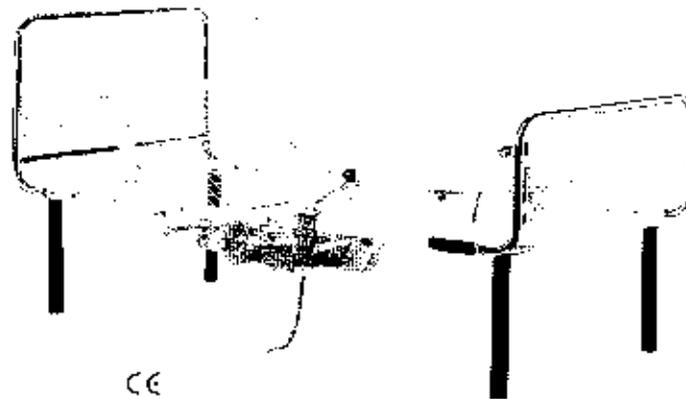

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
18.12.10.003	Letto articolato elettrico	712.00
18.12.12.103	Base elettrica per letto regolabile in altezza	735.00

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
18.12.27.103	Sponde di contenimento(paio)	109.00
24.36.06.103	Set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letto	50.00

Handwritten signature and numbers:
 82
 35
 27

LETTO ELETTRICO

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

- PANNELLO TETSTATA/PEDIERA(2 PZ)
- GANCIO IN FERRO SPONDE(2 PZ)

TOTALE € 44.00

-SCONTO 20% € 35.20

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Incelofanatura.

Sostituzione non obbligatoria di componenti, solo se ritenuti usurati a seguito di una valutazione da parte del tecnico:

- MOTORE RETE/BASAMENTO
€ 362.00
- PULSANTELA RETE/BASAMENTO
€ 62.00

REVISIONE NON OBBLIGATORIA :

- ORGANI DI MOVIMENTO STATICI
€ 23.00

SECONDA FASE

- Individuazione dell'ausilio, sulla base della prescrizione medica, delle caratteristiche morfologiche e di utilizzo.
- Addestramento all'uso: prova e verifica delle funzionalità dell'ausilio con l'utente dall'addetto tecnico.
- Consegna domiciliare 3 giorni lavorativi dall'autorizzazione.
- Verifica pos-vendita del mantenimento dei requisiti di funzionalità.

VALORE ECONOMICO DEL DISPOSITIVO NUOVO:

€ 712.00

€ 1447.00 (RETE+BASAMENTO)

RIEPILOGO DEI COSTI	
DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	35.20
IGIENIZZAZIONE	25.00
RITIRO E RICONSEGNA	15.00
*MANODOPERA	20.00
TOTALE	95.20

* N.B. IL COSTO DELLA MANODOPERA COMPRESI
S'IA IL RIPRISTINO OBBLIGATORIO CHE EVENTUALI
SOSTITUZIONI NON OBBLIGATORIE


M
136
28

LETTO oleodinamico**INDICAZIONI**

- Facilita l'assistenza in quanto permette di variare l'assetto del letto e quindi l'allineamento del paziente allettato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Letto a due manovelle per regolazione dell'alzatetesta e alzagambe
- Rete collegata a telaio a tre snodi
- Struttura regolabile in altezza tramite pompa oleodinamica
- Pannelli in laminato plastico
- Inclinazione della testata max 60°, portata 70 kg
- Inclinazione della pediera max 40°, portata 50 kg
- Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento
- Portata massima 135 kg

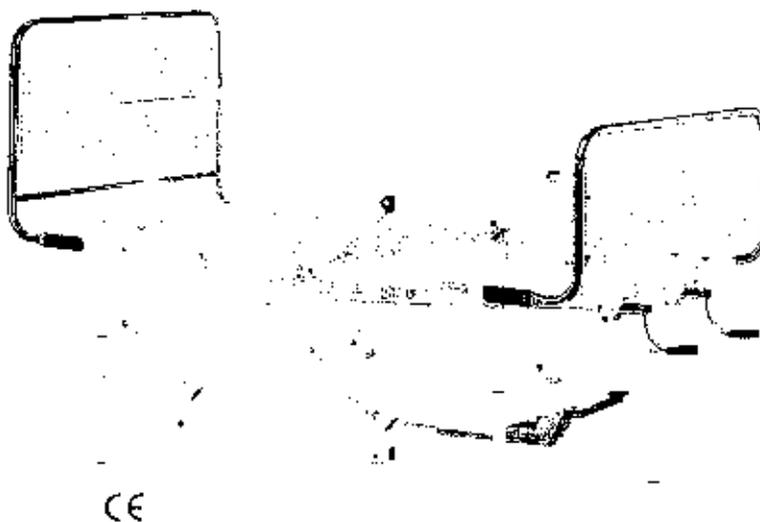

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
18.12.07.006	Letto ortopedico a due manovelle regolabili manualmente	305.00
18.12.12.106	Base per letto regolabile in altezza con pompa oleodinamica	404.00

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
18.12.27.103	Sponde di contenimento(paio)	109.00
24.36.06.103	Set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letto	50.00

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a large signature and the numbers 82, 37, and 209.

LETTO MANUALE

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

- MANOVELLA COMPLETA TESTATA
- MANOVELLA COMPLETA PEDIERA
- PANNELLO TESTATA/PEDIERA(2 PZ)
- GANCIO IN FERRO SPONDE(2 PZ)

TOTALE € 118.00
- SCONTO 20% € 94.40

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Incollatura.

Sostituzione non obbligatoria di componenti, solo se ritenuti usurati a seguito di una valutazione da parte del tecnico:

- IMPUGNATURA COMPLETA MANOVELLA (1PZ) € 11.00
- BOCCOLA FILETTATA MANOVELLA (1 PZ) € 2.00
- POMPA OLEODINAMICA BASAMENTO € 190.00

REVISIONE NON OBBLIGATORIA :

- ORGANI DI MOVIMENTO STATICI € 23.00

SECONDA FASE

- Individuazione dell'ausilio, sulla base della prescrizione medica, delle caratteristiche morfologiche e di utilizzo.
- Addestramento all'uso: prova e verifica delle funzionalità dell'ausilio con l'utente dall'addetto tecnico.
- Consegna domiciliare 3 giorni lavorativi dall'autorizzazione .
- Verifica pos-vendita del mantenimento dei requisiti di funzionalità:

**VALORE ECONOMICO DEL
DISPOSITIVO NUOVO:**
€ 709.00

RIEPILOGO DEI COSTI	
DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	94.40
IGIENIZZAZIONE	25.00
RITIRO E RICONSEGNA	15.00
*MANODOPERA	20.00
TOTALE	154.40

* N.B. IL COSTO DELLA MANODOPERA COMPRENDE SIA IL RIPRISTINO OBBLIGATORIO CHE EVENTUALI SOSTITUZIONI NON OBBLIGATORIE


M. 38

LETTO MANUALE**INDICAZIONI**

- Facilita l'assistenza in quanto permette di variare l'assetto del letto e quindi l'allineamento del paziente allettato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Letto ad una manovella per regolazione dell'alzatasta
- Rete collegata a telaio articolato ad uno snodo
- Pannelli in laminato plastico
- Inclinazione della testata max 60°, portata 70 kg
- Peso kg 38
- Portata massima 135 kg
- Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento

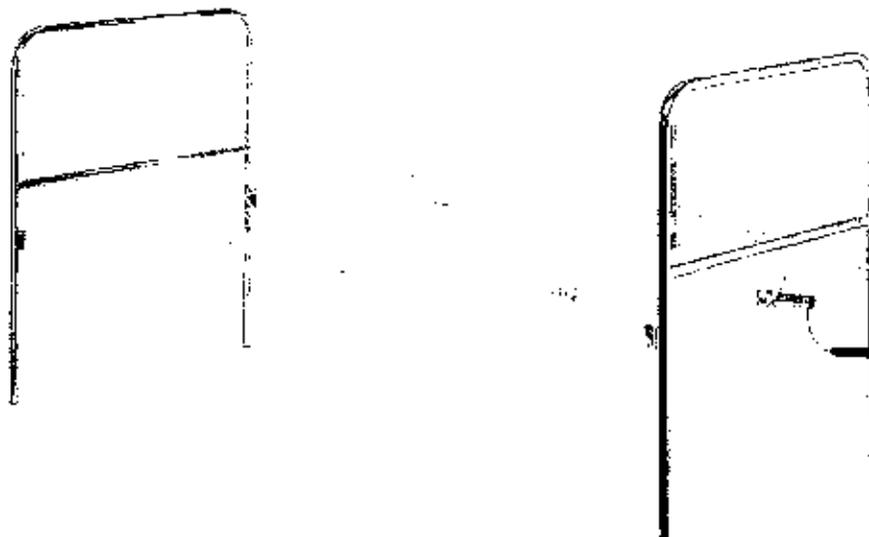

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
18.12.07.003	Letto ortopedico a una manovella regolabile manualmente	243.00

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
18.12.27.103	Sponde di contenimento(paio)	109.00
24.36.06.103	Set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letto	50.00



 22
 39
 21

LETTO MANUALE

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

- MANOVELLA COMPLETA TESTATA
- PANNELLO TESTATA/PEDIERA(2 PZ)
- GANCIO IN FERRO SPONDE(2 PZ)

TOTALE € 81.00
- **SCONTO 20% € 64.80**

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Incelofanatura.

Sostituzione non obbligatoria di componenti, solo se ritenuti usurati a seguito di una valutazione da parte del tecnico:

- IMPUGNATURA COMPLETA MANOVELLA (1PZ) € 11.00
- BOCCOLA FILETTATA MANOVELLA (1 PZ) € 2.00

REVISIONE NON OBBLIGATORIA :

- ORGANI DI MOVIMENTO STATICI € 23.00

SECONDA FASE

- Individuazione dell'ausilio, sulla base della prescrizione medica, delle caratteristiche morfologiche e di utilizzo.
- Addestramento all'uso: prova e verifica delle funzionalità dell'ausilio con l'utente e all'addetto tecnico.
- Consegna domiciliare 3 giorni lavorativi dall'autorizzazione.
- Verifica pos-vendita del mantenimento dei requisiti di funzionalità.

RIEPILOGO DEI COSTI	
DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	64.80
IGIENIZZAZIONE	25.00
R.TIRO E RICONSEGNA	15.00
*MANODOPERA	20.00
TOTALE	124.80

VALORE ECONOMICO DEL DISPOSITIVO NUOVO:

€ 243.00

* N.B. IL COSTO DELLA MANODOPERA COMPRENDE SIA IL RIPRISTINO OBBLIGATORIO CHE EVENTUALI SOSTITUZIONI NON OBBLIGATORIE

124.80
22

LETTO MANUALE


DISPOSITIVO MEDICO RIUTILIZZABILE

INDICAZIONI

- Facilita l'assistenza in quanto permette di variare l'assetto del letto e quindi l'allineamento del paziente allettato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Letto a due manovelle per regolazione dell'alzata testa e alzagambe
- Rete collegata a telaio a tre snodi
- Pannelli in laminato plastico
- Inclinazione della testata max 60°, portata 70 kg
- Inclinazione della pediera max 40°, portata 50 kg
- Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento
- Portata massima 135 kg

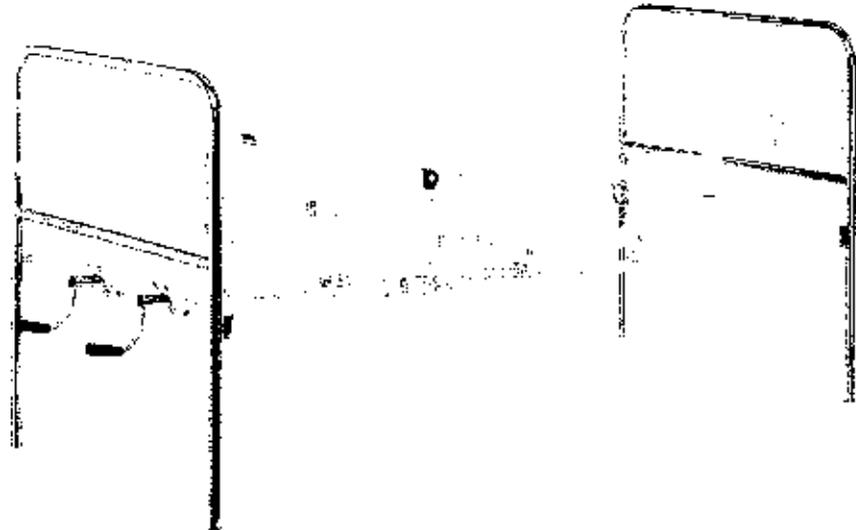

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
18.12.07.006	Letto ortopedico a due manovelle regolabili manualmente	305.00

Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
18.12.27.103	Sponde di contenimento (paio)	109.00
24.36.06.103	Set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letto	50.00

AS
41
33

LETTO MANUALE

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

- MANOVELLA COMPLETA TESTATA
- MANOVELLA COMPLETA PEDIERA
- PANNELLO TESTATA/PEDIERA(2 PZ)
- GANCIO IN FERRO SPONDE(2 PZ)

TOTALE € 118.00
-SCONTO 20% 94.40

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Incetofanatura.

Sostituzione non obbligatoria di componenti, solo se ritenuti usurati a seguito di una valutazione da parte del tecnico:

- IMPUGNATURA COMPLETA MANOVELLA (1PZ) € 11.00
- BOCCOLA FILETTATA MANOVELLA (1 PZ) € 2.00

REVISIONE NON OBBLIGATORIA :

- ORGANI DI MOVIMENTO STATICI € 23.00

SECONDA FASE

- Individuazione dell'ausilio, sulla base della prescrizione medica, delle caratteristiche morfologiche e di utilizzo.
- Addestramento all'uso: prova e verifica delle funzionalità dell'ausilio con l'utente dall'addetto tecnico.
- Consegna domiciliare 3 giorni lavorativi dall'autorizzazione.
- Verifica pos-vendita del mantenimento dei requisiti di funzionalità:

RIEPILOGO DEI COSTI	
DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	94.40
IGIENIZZAZIONE	25.00
RITIRO E RICONSEGNA	15.00
MANODOPERA	20.00
TOTALE	154.40

VALORE ECONOMICO DEL DISPOSITIVO NUOVO:
€ 305.00

* N.B. IL COSTO DELLA MANODOPERA COMPRENDE SIA IL RIPRISTINO OBBLIGATORIO CHE EVENTUALI SOSTITUZIONI NON OBBLIGATORIE


Handwritten signature and initials
42
34

INDICAZIONI

- Montascale mobile a cingoli che facilita l'assistenza nella locomozione consentendo il superamento di rampe di scale a soggetti in carrozzina o comunque con impedita o ridotta attività motoria

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Non richiede nessuna modifica alle scale
- Può essere facilmente trasportato sull'auto perché smontabile in due pezzi
- E' possibile far salire il mezzo tramite un comando elettrico, senza fatica
- Motore MP 56,5 12v- 18w in S2 IP 5-5
- Freno elettromagnetico
- Trasmissione riduttore con ingranaggi d'acciaio; segue cinghia dentata; il freno è montato direttamente sul riduttore per bloccare l'apparecchio anche in caso di rottura della cinghia; trasmissione finale con portata 900 kg
- Accumulatore sigillato, ricaricabile, senza manutenzione
- Peso kg 52 trasportabile kg 150

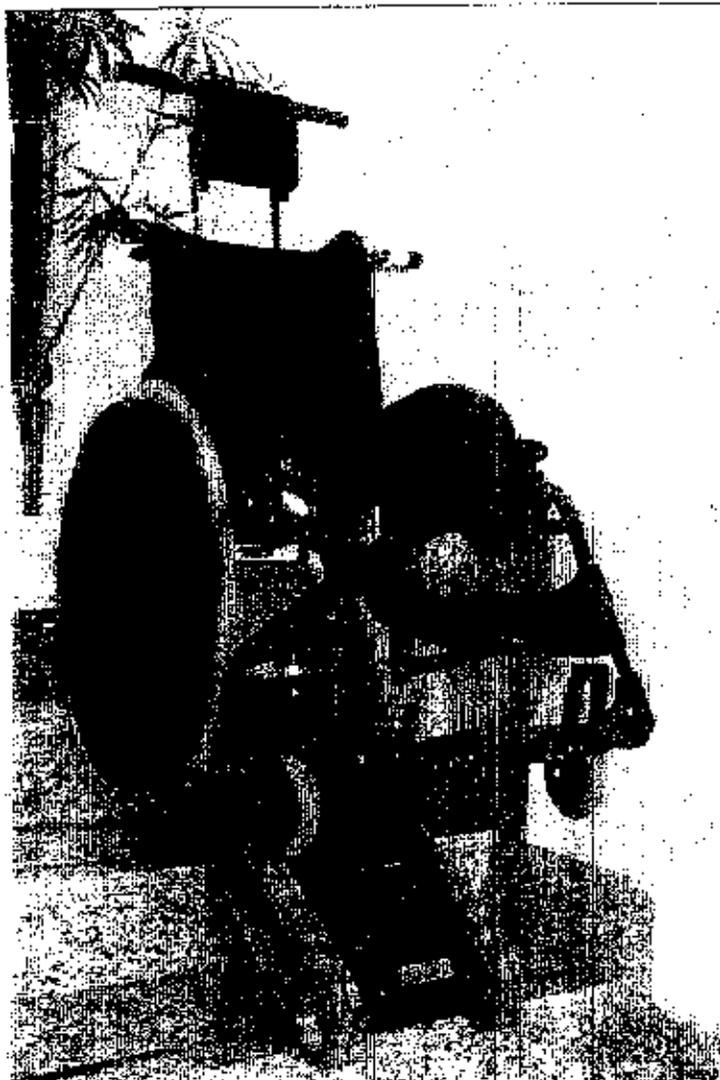

CODICI ISO	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
18.30.12.003	Montascale mobile a cingoli	3718.49

M. 43
35

MONTASCALE

Ciclo di vita :5 anni

GARANZIA
Delle parti sostitutive e
riparazioni : 6 mesi data
consegna

COMPONENTI DI RIPRISTINO OBBLIGATORI

* Considerata la complessa natura del presidio in oggetto e, la funzione da esso svolta, si rimanda al produttore la valutazione dei componenti da sostituire di volta in volta.

PRIMA FASE

- Ritiro presso il domicilio.
- Lavaggio e igienizzazione dell'ausilio con appositi prodotti.
- Sostituzione totale di tutti i componenti obbligatori del dispositivo.
- Applicazione libretto manuale d'istruzioni all'uso e di manutenzione ordinaria:
 - applicazione di quanto previsto dalla direttiva 93/42 CE a garanzia della sicurezza d'uso del dispositivo medico.
- Incelofanatura.

SECONDA FASE

- Individuazione dell'ausilio, sulla base della prescrizione medica, delle caratteristiche morfologiche e di utilizzo.
- Addestramento all'uso: prova e verifica delle funzionalità dell'ausilio con l'utente dall'addetto tecnico.
- Consegna domiciliare 3 giorni lavorativi dall'autorizzazione.
- Verifica pos-vendita del mantenimento dei requisiti di funzionalità.

* **Sostituzione** non obbligatoria di componenti, solo se ritenuti usurati a seguito di una valutazione da parte del tecnico:

- Da valutare volta per volta

* **REVISIONE NON OBBLIGATORIA :**

- Da valutare volta per volta

RIEPILOGO DEI COSTI

DESCRIZIONE	PREZZO (€)
KIT DI RIPRISTINO OBBLIGATORIO	*
IGIENIZZAZIONE	25.00
RITIRO E RICONSEGNA	15.00
MANODOPERA	*
TOTALE	

**VALORE ECONOMICO DEL
DISPOSITIVO NUOVO:**

€ 3718.49



Handwritten signature and date: 8/4/20